




Блок электронный «Аудио-СМАРТ»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.gov.ru



Блок для импедансометрии «Аудио-СМАРТ»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gozdravnadzor.gov.ru

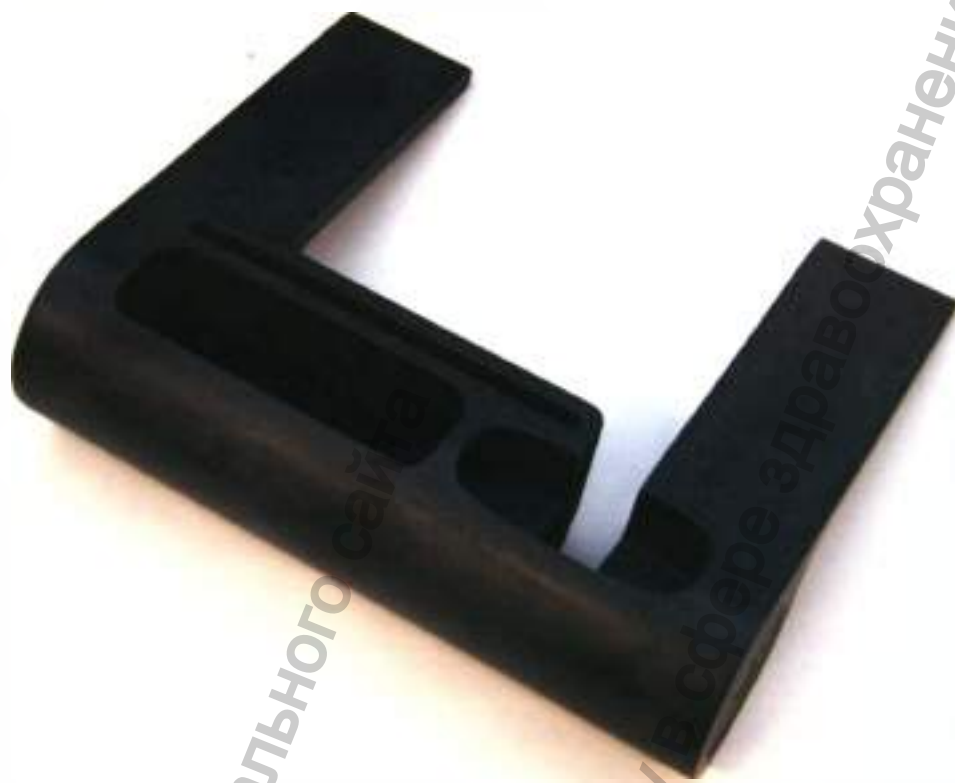

Подставка NS080200.003



Подставка NS057221.002

Информация получена с официального сайта
Федерального центра по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Блок питания «БЦМ-9»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.gov.ru



Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам ER3-14A

Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам ER3-14DC

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.gov.ru




Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим
телефонам ER3-14D2



Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим телефонам ER3-14B

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdramnadzor.gov.ru

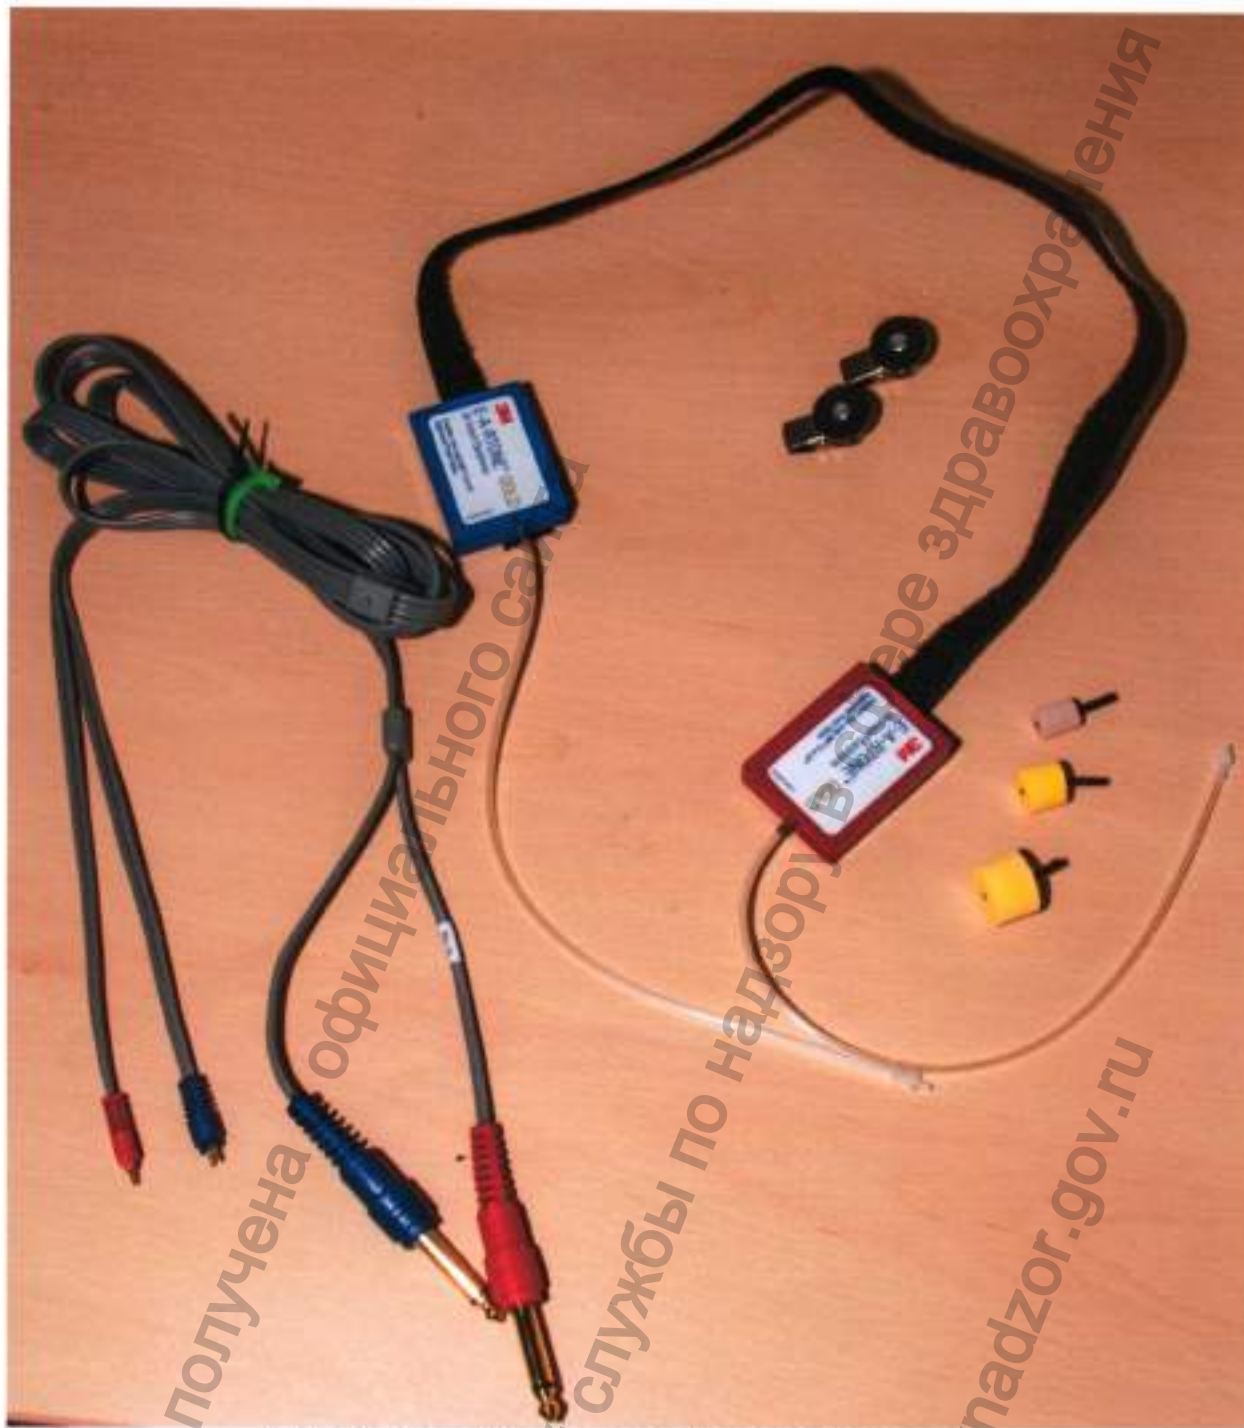

Телефоны аудиометрические внутришние

Информация получена
официального сайта
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
www.gosdrampadzor.gov.ru



Ремешок нашейный



Съемник наконечника зонда

Информация получена с официальной интернет-страницы
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Наконечник к зонду ОАЭ



Переходник к телефонам аудиометрическим

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Зонд для регистрации ОАЭ «ОАЭ-04-2»



Адаптер Bluetooth

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru



Комплект вкладышей ушных «детский»



Комплект вкладышей ушных «универсальный»



Комплект вкладышей ушных к аудиометрическим
телефонам EK3-14P2



Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39»



Слуховой стимулятор «TDH-39» односторонний



Полость тестовая

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Полость тестовая «ТП-1»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Полость тестовая «ТП-0,5»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Полость тестовая «ТП-0,2»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Полость тестовая «ТП-2»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru
Правоохранения



Полость тестовая «ТП-5»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Полость тестовая «ТП-8»

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, зеленый, синий, красный



Кабель для подключения электродов

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.gov.ru

Карта памяти



Кабель сетевой





Зубная нить для чистки кончика зонда Superfloss Regular

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramnadzor.gov.ru



Паста электродная контактная



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП»,
зеленый, красный, черный



Электрод одноразовый в упаковке

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.gov.ru
Янтарного хранилища



FIAB

FIAB S.p.a Via Costelli, 4 Viechio (FI) Italy

REF G999

Everi

Conductive and abrasive paste
Especially made to reduce
The skin impedance during
E.E.G. - E.P. - E.C.G. - HOLTZER
STRESS TEST examination

Directions for use: shake the bottle, apply a thin layer
on the patient skin and rub gently the area where
electrodes are to be applied.

External use only



Net weight **160 g e**

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdrazhnadzor.gov.ru

Паста абразивная

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

ПРОЦУРОВАНО
ПРОЦУРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
И. С. ПРАТК
ПРЕЗИДЕНТ ООО «ВЕРСОФТ»
А. Б. ШУБИН



www.goszdravnadzor.ru