



«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации
медицинских изделий



Тихонова М.А.

«31» июля 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Шприцы MEDRAD® для рентгеноконтрастных / магнитоконтрастных
веществ и физиологического раствора к системам инъекционным
MEDRAD® Stellant Sx, MEDRAD® Stellant D, MEDRAD® Stellant DualFlow,
MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией Certegra, MEDRAD® Spectris
Solaris EP, Mark V ProVis, Vistron CT, в наборах

АО «БАЙЕР»

107113 Россия, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.2

Тел.: (495) 234 20 00
Факс: (495) 234 20 01

www.bayer.ru



1. 150-FT-Q в составе: 1.1 Шприц стерильный одноразовый 150 мл; 1.2 Трубка быстрого наполнения.

Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке: 150-FT-Q



medrad® Mark V ProVis
Disposable Syringe 150 mL & QFT
Шприц стерильный одноразовый
150 мл и Трубка быстрого наполнения

- Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости
- Do not use if package is opened or damaged
Не используйте вскрытые или поврежденные упаковки
- Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton
ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений о мерах предосторожности изучите инструкцию по применению, вложенную в упаковку
- Single use only
Использовать только один раз
- Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения
- NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
Not made with Natural Rubber Latex / Сделано без применения натурального латекса

Rx Only Assembled in USA

Catalog Number
Номер по каталогу **150-FT-Q**

Date of Manufacture
Дата производства **2017-04-12**

Use By
Использовать до **2020-04-12**

Lot Number
Номер партии **Lot_Number**

(01)00616258010991
(11)170412
(17)200412
(10)Lot_Number

Производитель

Байер Медикал Кэа Инк., США Bayer Medical Care Inc. 1 Bayer Drive Indianola, PA 15051-0780 U.S.A.	Bayer Medical Care B.V. Horsterweg 24 6199 AC Maastricht Airport The Netherlands

Patent Information/Патентная информация:
www.ripatents.bayer.com Сделано в США

Импортер на территорию России:
АО «БАЙЕР» Бизнес-юнит «Радиология»,
107113, 3-я Рыбинская ул.,
д.18, стр.2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200 www.bayer.ru

РУ № ФСЗ 2012/12543
от 26 февраля 2016 года.

Bayer
CE 0086



P85668552
Rev. 1

(01)00616258010991






Информация от производителя с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru



2. 200- FT-Q в составе: 2.1 Шприц FasTurn стерильный одноразовый 200 мл; 2.2 Трубка быстрого наполнения.



MEDRAD® Mark V ProVis
200mL FasTurn Sterile Disposable Syringe & QFT / Шприц FasTurn стерильный
одноразовый 200 мл и Трубка быстрого
наполнения


-  Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости
-  Do not use if package is opened or damaged
Не используйте вскрытые или поврежденные упаковки
-  Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton
ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений о мерах предосторожности изучите инструкцию по применению, вложенную в упаковку
-  Single use only
Использовать только один раз
-  Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX Not made with Natural Rubber Latex / Сделано без применения натурального латекса

Rx Only Assembled in USA

REF Catalog Number
Номер по каталогу **200-FT-Q**

 Date of Manufacture
Дата производства **2017-04-12**

 Use By
Использовать до **2020-04-12**

LOT Lot Number
Номер партии **Lot_Number**

 (01)00616258011004
(11)170412
(17)200412
(10)Lot_Number

Производитель
 Байер Медикал Кэа Инк., Bayer Medical Care B.V.
 США Horsterweg 24
 Bayer Medical Care Inc. 6199 AC Maastricht
 1-Bayer Drive Airport
 Indianapolis, PA 15051-0780 The Netherlands
 U.S.A.

Patent Information/Патентная информация:
www.rapatents.bayer.com Сделано в США

Импортёр на территорию России:
 АО «БАЙЕР» Бизнес-юнит «Радиолюмия»,
 107113, 3-я Рыбинская ул,
 д.18, стр.2, Москва, Россия
 тел.: +7 495 231 1200 www.bayer.ru

РУ № ФСЗ 2012/12543
 от 26 февраля 2016 года

Bayer
 0086

 P85687263
 Rev. 1

(01)00616258011004

Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке 200-FT-Q

Информация от Росздравнадзора с официального сайта в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке CTP-200-FLS



СТРИ-РАК Sterile Disposable Syringe

Disposable kit for the ST Injector System from Bayer

Contents: 1 - 200ml Quick-Fit Syringe, 1 - Colored Low

Pressure Indicator Tube, 1 - Quick-Fit Tube

Шприц ТРИ-РАК стерильный одноразовый для КТ

Набор одноразовый для системы инъекционной

для КТ компании Байер

В составе: 1 - Шприц Quick-Fit 200мл, 1 - Трубка

соединительная низко давлении, 1 - Трубка

бестерильная

Мод-группы Fluid path

Непрерывный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged

Не используйте в открытые или поврежденные

упаковки

Attention: Refer to warnings and cautions on

Instructions for Use packard in each carton

DO NOT EXCEED 355psi (2446kPa)

ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных

сведений о мерах предосторожности и/или

инструкцию по применению, вложенную в

упаковку НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (2446 кПа)

3 пинча до (или

используя пинцет)

Стерилизован в индивидуальной

упаковке

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

Not made with Natural Rubber Latex / Сделано без натурального латекса

Assembled in USA

Rx Only

Catalog Number

СТР-200-FLS

REF Номер по каталогу

2017-04-12

Date of Manufacture

Дата производства

2022-04-12

LOT Номер партии

Lot Number

Lot Number

(01)00616258011028

(11)170412

(17)220412

Lot Number

5

10Xlot Number



Производитель:

Байер Медикал Кза Инк.,

США

Bayer Medical Care Inc.

1 Valley Drive

Wayland, MA 01981-0780

U.S.A.

The Netherlands

Patent Information: Для получения информации

www.patents.bayer.com

Импортер на территории России: Сделано в США

АО «БАЙЕР» Бизнес-юнит «Радиофармацевтика»

107113, Э-П Российская ул.,

д. 28, стр. 2, Москва, Россия

Тел.: +7 495 231 2000 www.bayer.ru

РФ № ФСЗ 2012/12543 от 26 февраля 2016 года


PG 566 8579

Rev. 1

(01)00616258011028



4. SSQK 65/115VS Набор одноразовый для системы инъекционной 65/115 MR для МРТ, в составе: 4.1.Шприц Qwik-Fit 65 мл для контрастного вещества; 4.2 Шприц Qwik-Fit 115 мл для физиологического раствора; 4.3 Маленькая игла для контрастного вещества; 4.4 Большая игла для физиологического раствора; 4.5 Трубка соединительная низкого давления системы инъекционной 65/115 MR 243,84 см

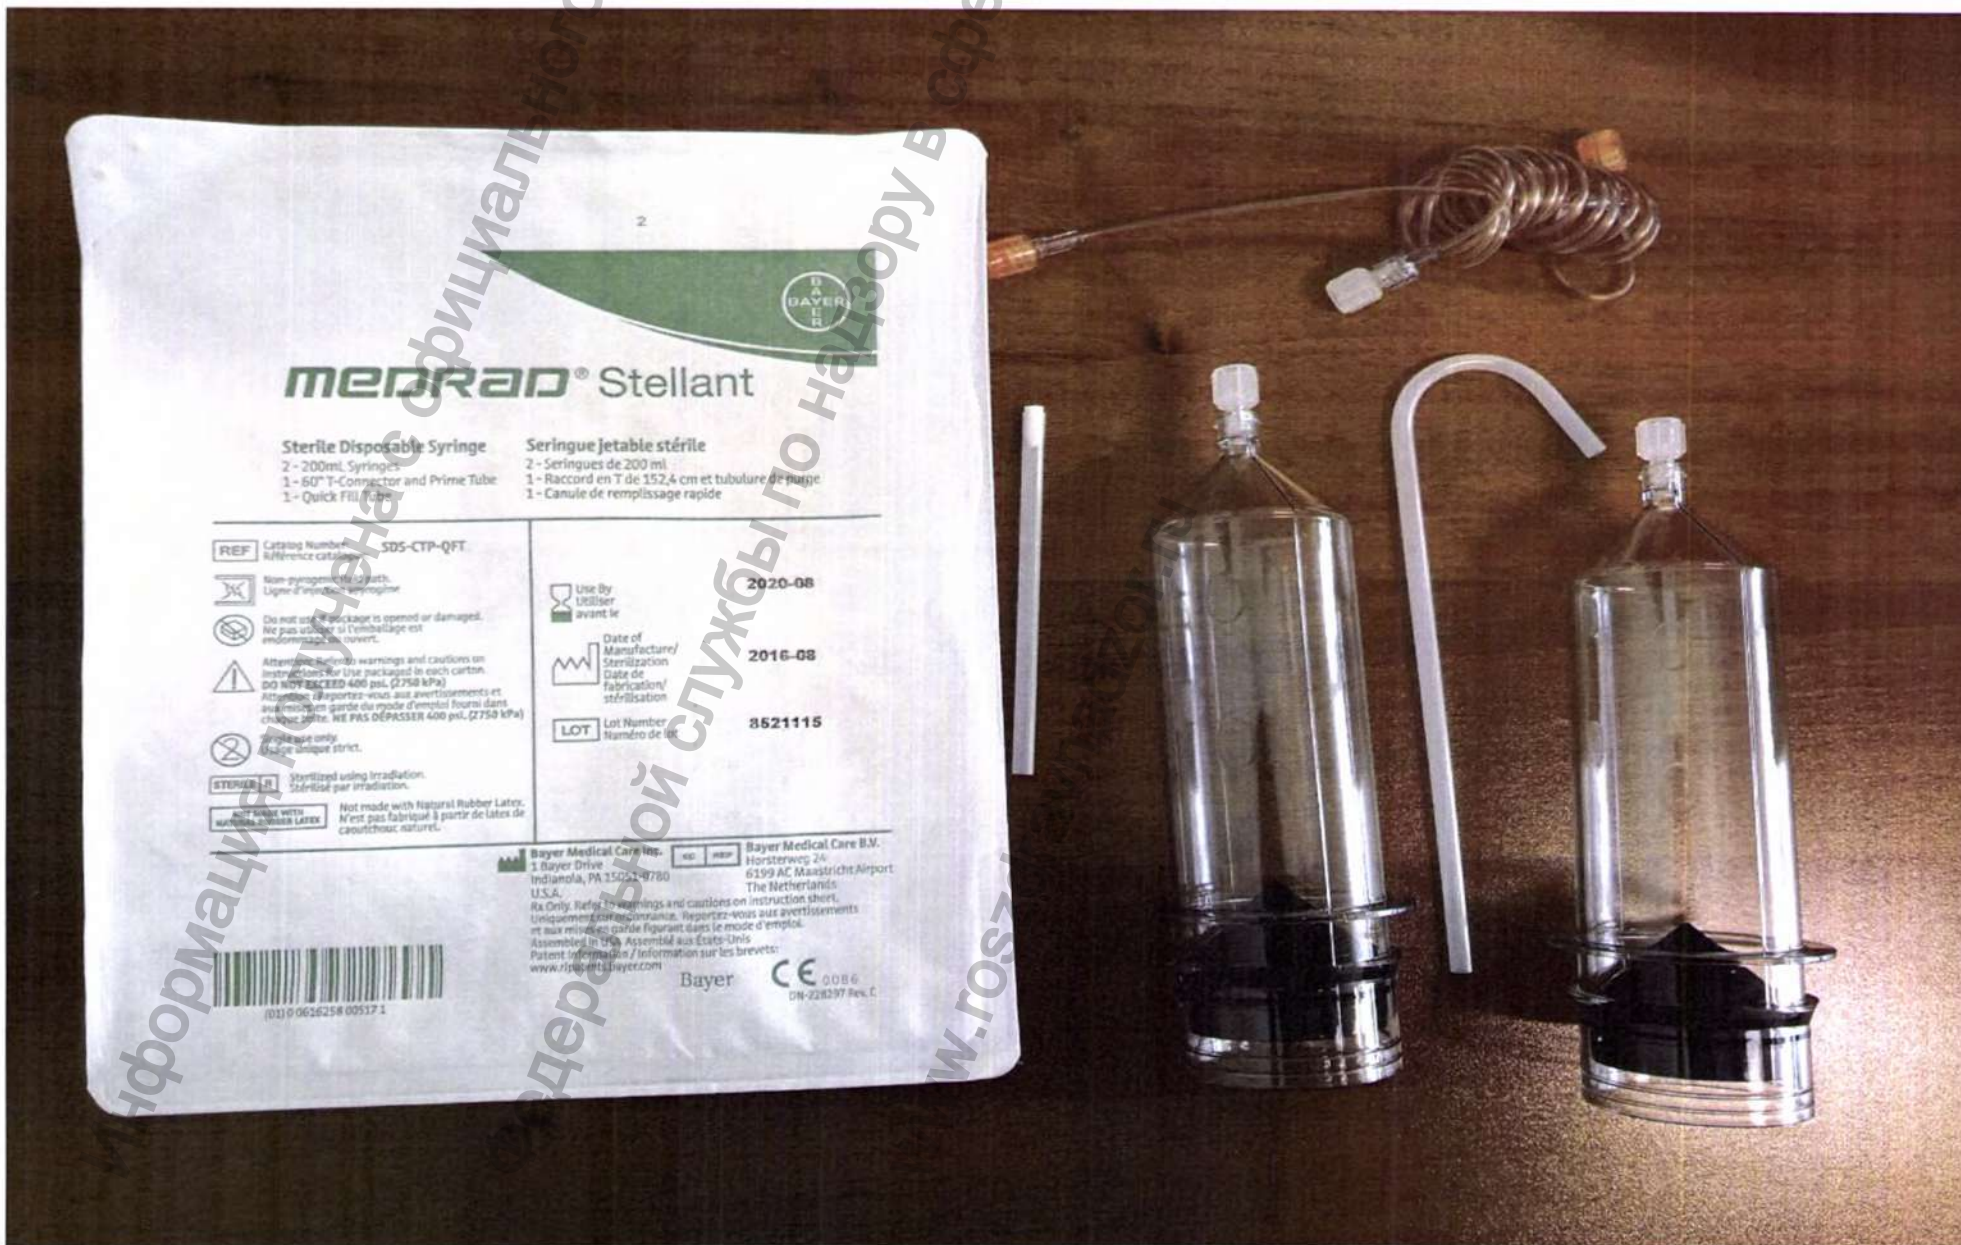

5. SDS-CTP-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: 5.1 Шприцы 200 мл – 2 шт.; 5.2 Трубка Т-образная соединительная 152,4 см; 5.3 Трубка для прокачки воздуха; 5.4 Трубка быстрого наполнения.



МЕРДРАД® Stellant

Sterile Disposable Syringe

- 2 - 200mL Syringes
- 1 - 60" T-Connector and Prime Tube
- 1 - Quick Fill Tube

- ## Шприц стерильный одноразовый
- 2 - Шприцы 200 мл
 - 1 - Трубка Т-образная соединительная 152, 4 см и Трубка для прокачки воздуха
 - 1 - Трубка быстрого наполнения



Салдо номеров:
Номер по каталогу:

SDS-CTP-QFT



Non-vented fluid path

Нетирочный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged!
Не используйте в случае если повреждена упаковка!



Attention: Refer to warnings and cautions on instruction for use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 400psi (2750kPa)
ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству по эксплуатации, расположенному, соответственно, в упаковке **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа**



Single use only
Использовать только один раз!



Sterilized using irradiation
Стерилизовано с использованием облучения



Made with Medical Rubber Latex
Сделано без применения натурального латекса

Rx Only



Use by
Использовать до



Date of
Manufacture
Дата
производства



LOT Number
Номер партии

space for
2D barcode



Производитель

Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэр Инк., США
107113, 3-я Рубинская ул.,
1-й этаж, Москва, Россия
Тел: +7(495) 2311200
www.bayer.ru



RU № ФСЗ 2012/12543
07.26.Февраль 2016 года

Bayer
Assembled in USA




Bayer Medical Care B.V.
Hortsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

DN-246020
Rev A



(01) 00616258011080

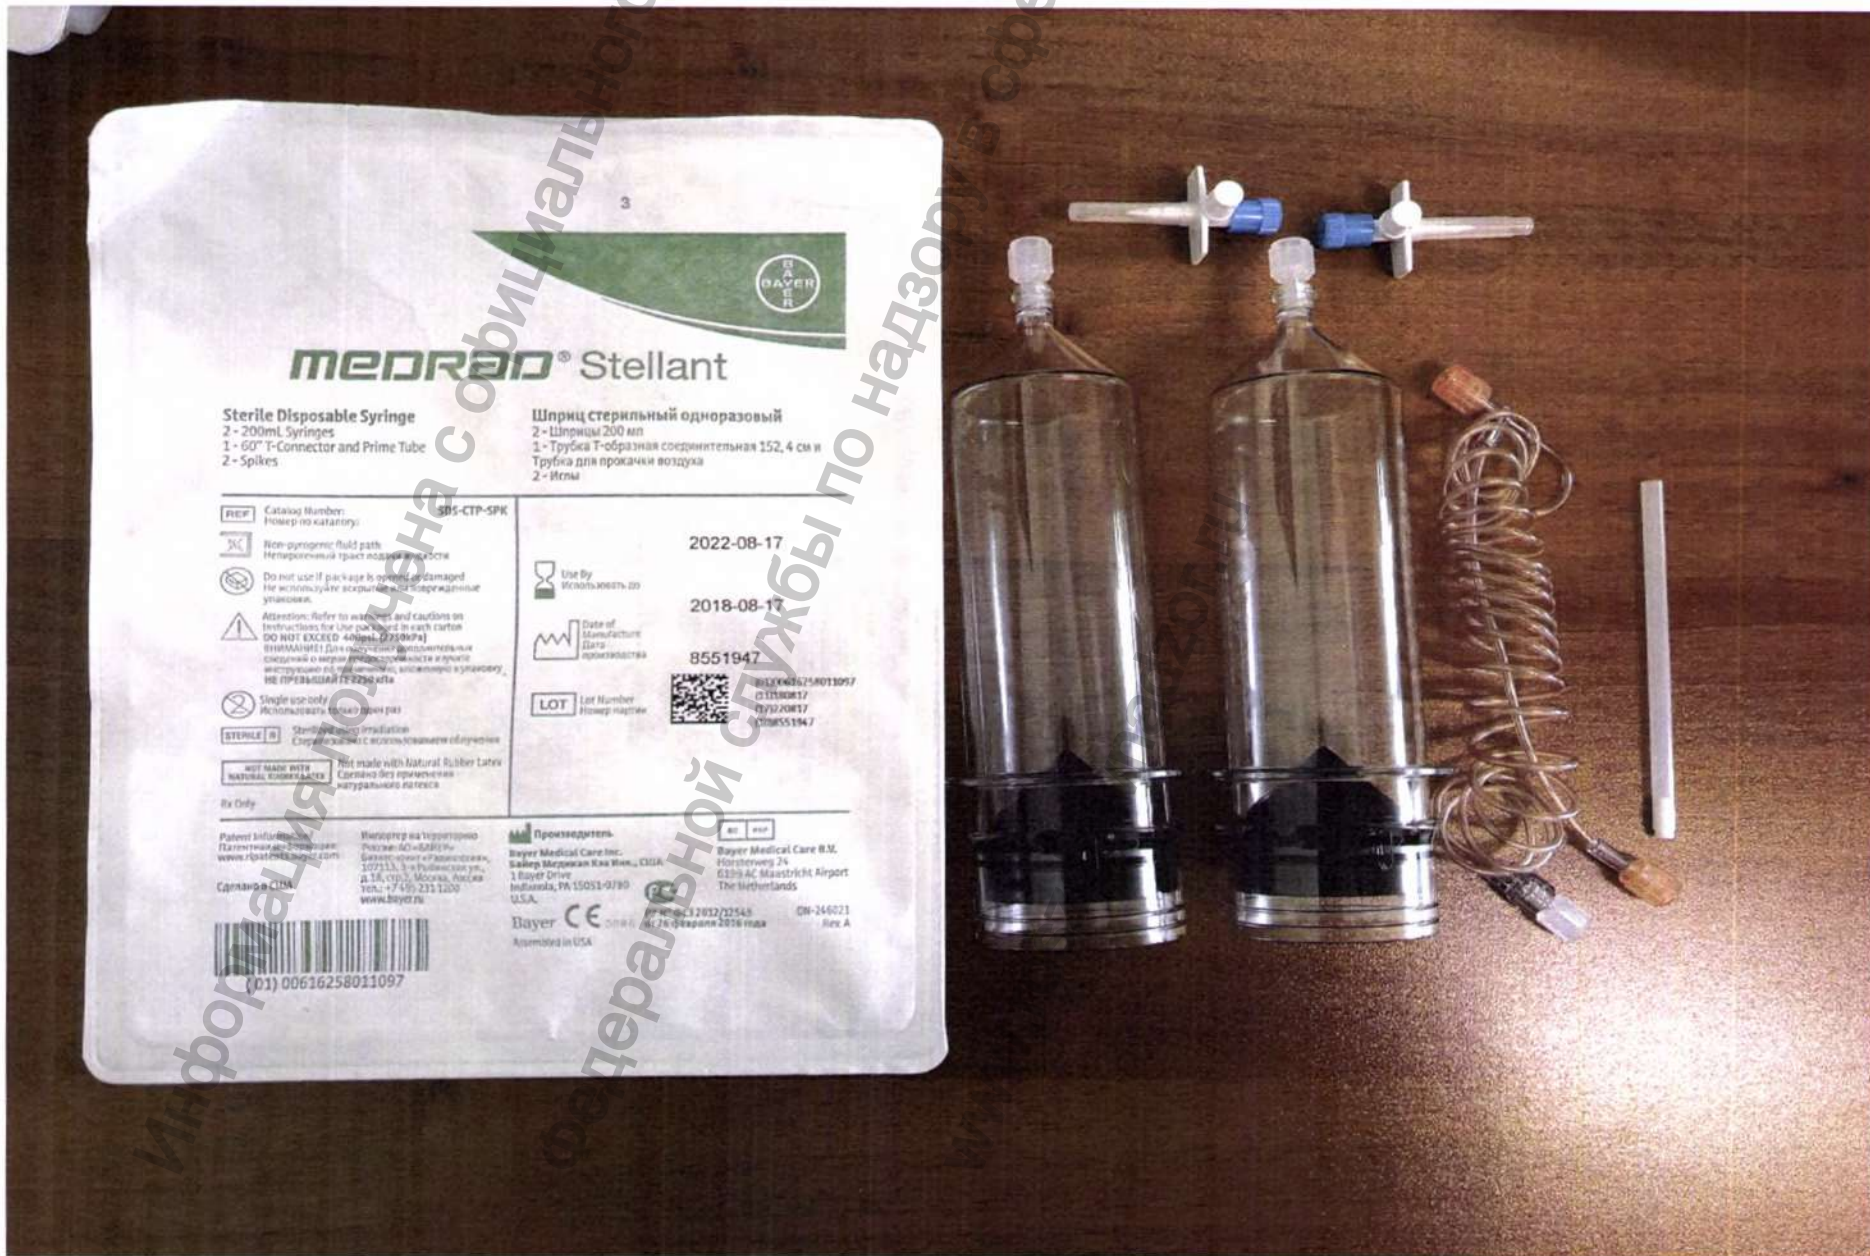

medrad® Stellant

Sterile Disposable Syringe
 2 - 200mL Syringes
 1 - 60" T-Connector and Prime Tube
 2 - Spikes

Шприц стерильный одноразовый
 2 - Шприцы 200 мл
 1 - Трубка Т-образная соединительная 152,4 см и
 Трубка для прокачки воздуха
 2 - Иглы

REF Catalog Number: **SDS-CTP-SPK**
 Номер по каталогу:

Non-pyrogenic fluid path
 Нетермогенный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged
 Не использовать вскрытый или поврежденный упаковку

Attention: Refer to warnings and cautions on instructions for use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 400mmHg (27.5kPa)
 Внимание! Для использования внимательно ознакомьтесь с предупреждениями и предостережениями в инструкции по применению, включенной в упаковку, НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 400 мм рт.ст.

Single use only
 Использовать только один раз

STERILE Sterilized by irradiation
 Стерильно обработано с использованием облучения

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
 This made with Natural Rubber Latex
 Сделано без натурального каучука

By Only

Patent Information
 Патентная информация
www.medrad.com

Сделано в США



Импортер на территории России ООО «БАРС»
 Фактический адрес: Москва, ул. 107113, 3-й этаж
 д.18, стр.1, Москва, Россия
 Тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Производитель:
 Bayer Medical Care Inc.
 Bayer Medical Care Inc., USA
 1 Bayer Drive
 Indianapolis, IN 46051-0780
 U.S.A.

Bayer
 Assembled in USA

2022-08-17

Use By
 Использовать до

2018-08-17

Date of Manufacture
 Дата производства

8551947

LOT Lot Number
 Номер партии



8551947
 11558017
 191220817
 018551947

lot exp

Bayer Medical Care B.V.
 Forstweg 24
 6130 AC Maastricht Airport
 The Netherlands

02012/22548
 01-26-Февраль 2016 года
 01-26-021
 Rev. A

6. SDS-CTP-SPK Шприц стерильный одноразовый в наборе: 6.1 Шприцы 200 мл – 2 шт; 6.2 Трубка Т-образная соединительная 152,4 см; 6.3 Трубка для прокачки воздуха; 6.4 Иглы – 2 шт.



МЕРПРАД® Stellant

Sterile Disposable Syringe

- 2 - 200ml Syringes
- 1 - 60° T-Connector and Prime Tube
- 2 - Spikes

Шприц стерильный одноразовый

- 2 - Шприцы 200 мл
- 1 - Трубка Т-образная соединительная 152,4 см
- Трубка для прокачки во воздуха
- 2 - Игла

<p>REF Serial Number Номер по каталогу</p>	<p>SDS-CTP-SPK</p>
<p>M Non-pressurized Fluid path Непрямой тракт подачи жидкости</p> <p>⚠ Do not use if packager is opened or damaged Не использовать в открытой или поврежденной упаковке</p> <p>⚠ Attention: Refer to warnings and cautions on instructions for use packaged in each carton DO NOT EXCEED 400psi (2750kPa) ВНИМАНИЕ: Если получены дополнительные сведения о шприце, сообщите о возможности их присутствия в инструкции по применению, расположенной в упаковке НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа</p>	<p>⌚ Use By Использовать до</p> <p>📅 Date of Manufacture Дата производства</p> <p>LOT Lot Number Номер партии</p>
<p>ⓧ Single Use Only Использовать только один раз</p> <p>STERILE R Sterile and ready for use Стерильно и готово к использованию</p> <p>NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX Not made with Natural Rubber Latex Сделано без натурального латекса каучукового происхождения</p>	<p>space for 2D barcode</p>

Patent Information:
Патентная информация:
www.bayer.com

Сделано в США

Импортер на территории России: АО «БАЙЕР»
Байерский завод «Рудольф Вильгельм»
107113, 3-й Рубинская ул., д. 28, стр. 2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Barcode: (01) 00616258011097

Производитель
Bayer Medical Service
Bayer Medical Service, Inc.
Bayer Medical Service, Inc., USA
1 Bayer Drive
Indialena, PA 15061-0780
USA

Производитель
Bayer Medical Service B.V.
Hindeloordse
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

CE **PC**

Важно! RU № ФСЗ032/234.3
0086 0726 февраля 2016 года

Assembled in USA

ON 245021 Rev. A

Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке SDS-CTP-SPK



7. SSS-СТП-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: 7.1 Шприц 200 мл; 7.2 Трубка витая соединительная низкого давления; 7.3 Трубка для прокачки воздуха; 7.4 Трубка быстрого наполнения.



МЕДГРАД® Stellant

Sterile Disposable Syringe

1 - 200ml Syringe, 1 - Colored Low Pressure Connector Tube and Prime Tube, 1 - Quik Fill Tube

Шприц стерильный одноразовый

1 - Шприц 200 мл, 1 - Трубка вставка соединительная колора давления и 1 трубка для прокачки воздуха, 1 - Трубка быстрого наполнения

SSS-CTP-QFT



Ссылочный номер по каталогу:



Может проколоть руку и глаза



Непереносимый препарат подачей жидкости



До использования встряхните и проверьте целостность упаковки



Attention: Before to using stand caution on

Instructions for Use: read and use caution DO NOT EXCEED 400psi (2750kpa) when using. Do not use for oxygen and air delivery. Do not use for oxygen and air delivery. Do not use for oxygen and air delivery.



Не использовать для подачи кислорода



Sterile and use only for disposal



Not made with Natural Rubber Latex. Safe for those allergic to natural rubber latex

Rx Only

Assembled in USA



Use By: Истечь срок годности



Date of Manufacture: Дата производства



Lot Number: Номер партии

space for 2D Barcode

Производитель

Bayer Medical Care Inc.
Bayer Medical Care Inc.
1 Valley Drive
Indianola, PA 15051-0780
USA

Производитель

Bayer Medical Care BV
Hertweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Сделано в США

Импортер на территории
Российской Федерации
107113, 3-й Рубинский в-ул,
д.18, стр.2, Москва, Россия
Тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Байер



РУ № ФСЗ012/12543
0126 фсралг 2016 года
DN 246017 Rev.A



(01) 00616258011059



8. SSS-CTP-SPK Шприц стерильный одноразовый в наборе: 8.1 Шприц 200 мл; 8.2 Трубка витая соединительная низкого давления; 8.3 Трубка для прокачки воздуха; 8.4 Игла



мерград® Stellant

Sterile Disposable Syringe

1 - 200 mL Syringe, 1 - Colloid Low Pressure Connector Tube and Plunger Tube, 1 Spike

Шприц стерильный одноразовый

1 - Шприц 200 мл, 1 - Трубчатая соединительная трубка коллоидного давления, 1 - Игла

Сетевой номер: SSS-CTP-SPK

REF Номер по каталогу:

Do not reuse or find rash. Неиспользуемый шприц поддается жидкости.

Do not use if package is so pined or damaged. Не используйте вскрытые или поврежденные упаковки.

Attention: Refer to warnings and cautions on the package. For User Manual in each carton. DO NOT EXCEED 400psi (2750kpa) (75mmHg). Длительное использование иглы может вызвать повреждение венозную систему. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа.

Single use only. Использовать только один раз.

Sterile and using irradiation. Стерильно и облучено. Не использовать с и другими вакцинами.

Not made with natural rubber latex. Не сделано из натурального латекса.

Assembled in USA.

Use by: Использовать до: [Symbol]

Lot Number: Номер партии: [Symbol]

Manufactured in: Произведено в: [Symbol]

space for 2D barcode

Производитель: Bayer Medical Care Inc., 1 Valley Drive, Indianapolis, IN 46280, USA

Валер Медикал Сэйр Б.В., Нортвестууд 2с, 6199 АС Маастрихтсбург Роуд, The Netherlands

Адрес: [Symbol]

Российский филиал: [Symbol]

Валер Медикал Сэйр Б.В., Нортвестууд 2с, 6199 АС Маастрихтсбург Роуд, The Netherlands

RU № ФСЗ 2012/12543, 01.06.2016 года, DN: 24.01.19 Rev. A

Шприц для рентгеноконтрастных веществ
и физиологического раствора к устройствам
для внутривенного введения, в наборе SSS-QFT
в составе: Шприц 200 мл, Трубка быстрого наполнения
Нетоксично



medrad Stellant

Sterile Disposable Syringe
200ml Syringe & QFT
Шприц стерильный одноразовый
Шприц 200 мл и Трубка быстрого наполнения

REF Catalog Number: 555-QFT
Номер по каталогу:

Non-radiation fluid path
Нестерильный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged.
Использовать вскрытые или поврежденные упаковки

Attention: Refer to warnings and cautions on
instructions for use packaged in each carton
Внимание! Обратитесь к предупреждениям и мерам
предосторожности, описанным в инструкции по применению
в упаковке НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа

DO NOT EXCEED 400psi. (2750kPa) (ВНИМАНИЕ) НЕ
превышайте допустимых значений по давлению
превышающих 400 фунтов на квадратный дюйм (2750 кПа)

Single use only
Использовать только один раз

STERILE Sterilized using irradiation
Стерильно с использованием облучения

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
Not made with Natural Rubber Latex
Синтетический материал
Натуральный латекс

Px Only Assembled in USA
Использовать только один раз

Use By 2022-10-28
Использовать до

Date of Manufacture 2018-10-28
Дата производства

LOT Lot Number 8554572
Номер партии

QR code and numbers: (01)00616258011042, (11)181028, (17)221028, (10)8554572

Manufacturer information: Bayer Medical Care Inc., Bayer Medical Care B.V.

Patent information: Patent Information/Patentная информация, www.patents.bayer.com

CE mark and registration numbers: CE, RU №ФС32012/12543, 00B6 0126 февраля 2016 года, 01-246016 НСХ А

Barcode and lot number: (01)00616258011042

Информация получена с официального сайта
Федеральному надзору в сфере здравоохранения
www.goszdrazhnadzor.ru

9. SSS-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: фото упаковки



9. SSS-QFT Шприц стерильный одноразовый в наборе: 9.1 Шприц 200 мл; 9.2Трубка быстрого наполнения.



Медрап® Stellant

Sterile Disposable Syringe

2000ml Syringe & QFT

Шприц стерильный одноразовый

Шприц 200 мл и Трубка быстрого наполнения

SSS-QFT

REF

Catalog Number:
Номер по каталогу:

35

Non-rupture fluid path
Непротечный тракт подачи жидкости



Do not use if package is opened or damaged/не
используйте вскрытые или поврежденные упаковки



Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton

DO NOT EXCEED 400psi (2750kPa)/ВНИМАНИЕ! Для
получения дополнительных сведений о мерах
предосторожности ищите инструкции по применению
вложенную в упаковку **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 кПа**



Single use only
Использовать только один раз

STERILE

Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

**NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX**

Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Rx Only

Assembled in USA



Use By
Использовать до



Date of
Manufacture
Дата
производства

LOT

Lot Number
Номер партии



Производитель

Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэа Инк., США
1 Bayer Drive
Iridandola, PA 15051-0780
USA

ЕС МЕР

Bayer Medical Care B.V.
Hortsteegweg 24
5199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Сделано в США

Импортер на территорию

Patent Information/
Патентная информация:
www.patents.bayer.com

Россия: АО «БАЙЕР»
Бизнес-центр «Радикология»,
107113, 3-я Рыбинская ул.,
д. 18, стр. 2, Москва, Россия
тел: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Байер




CE

RU № ФСЗ 2012/12543
DDE от 26 Февраля 2016 год. DN-246016-Кел. А



Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке SSS-QFT

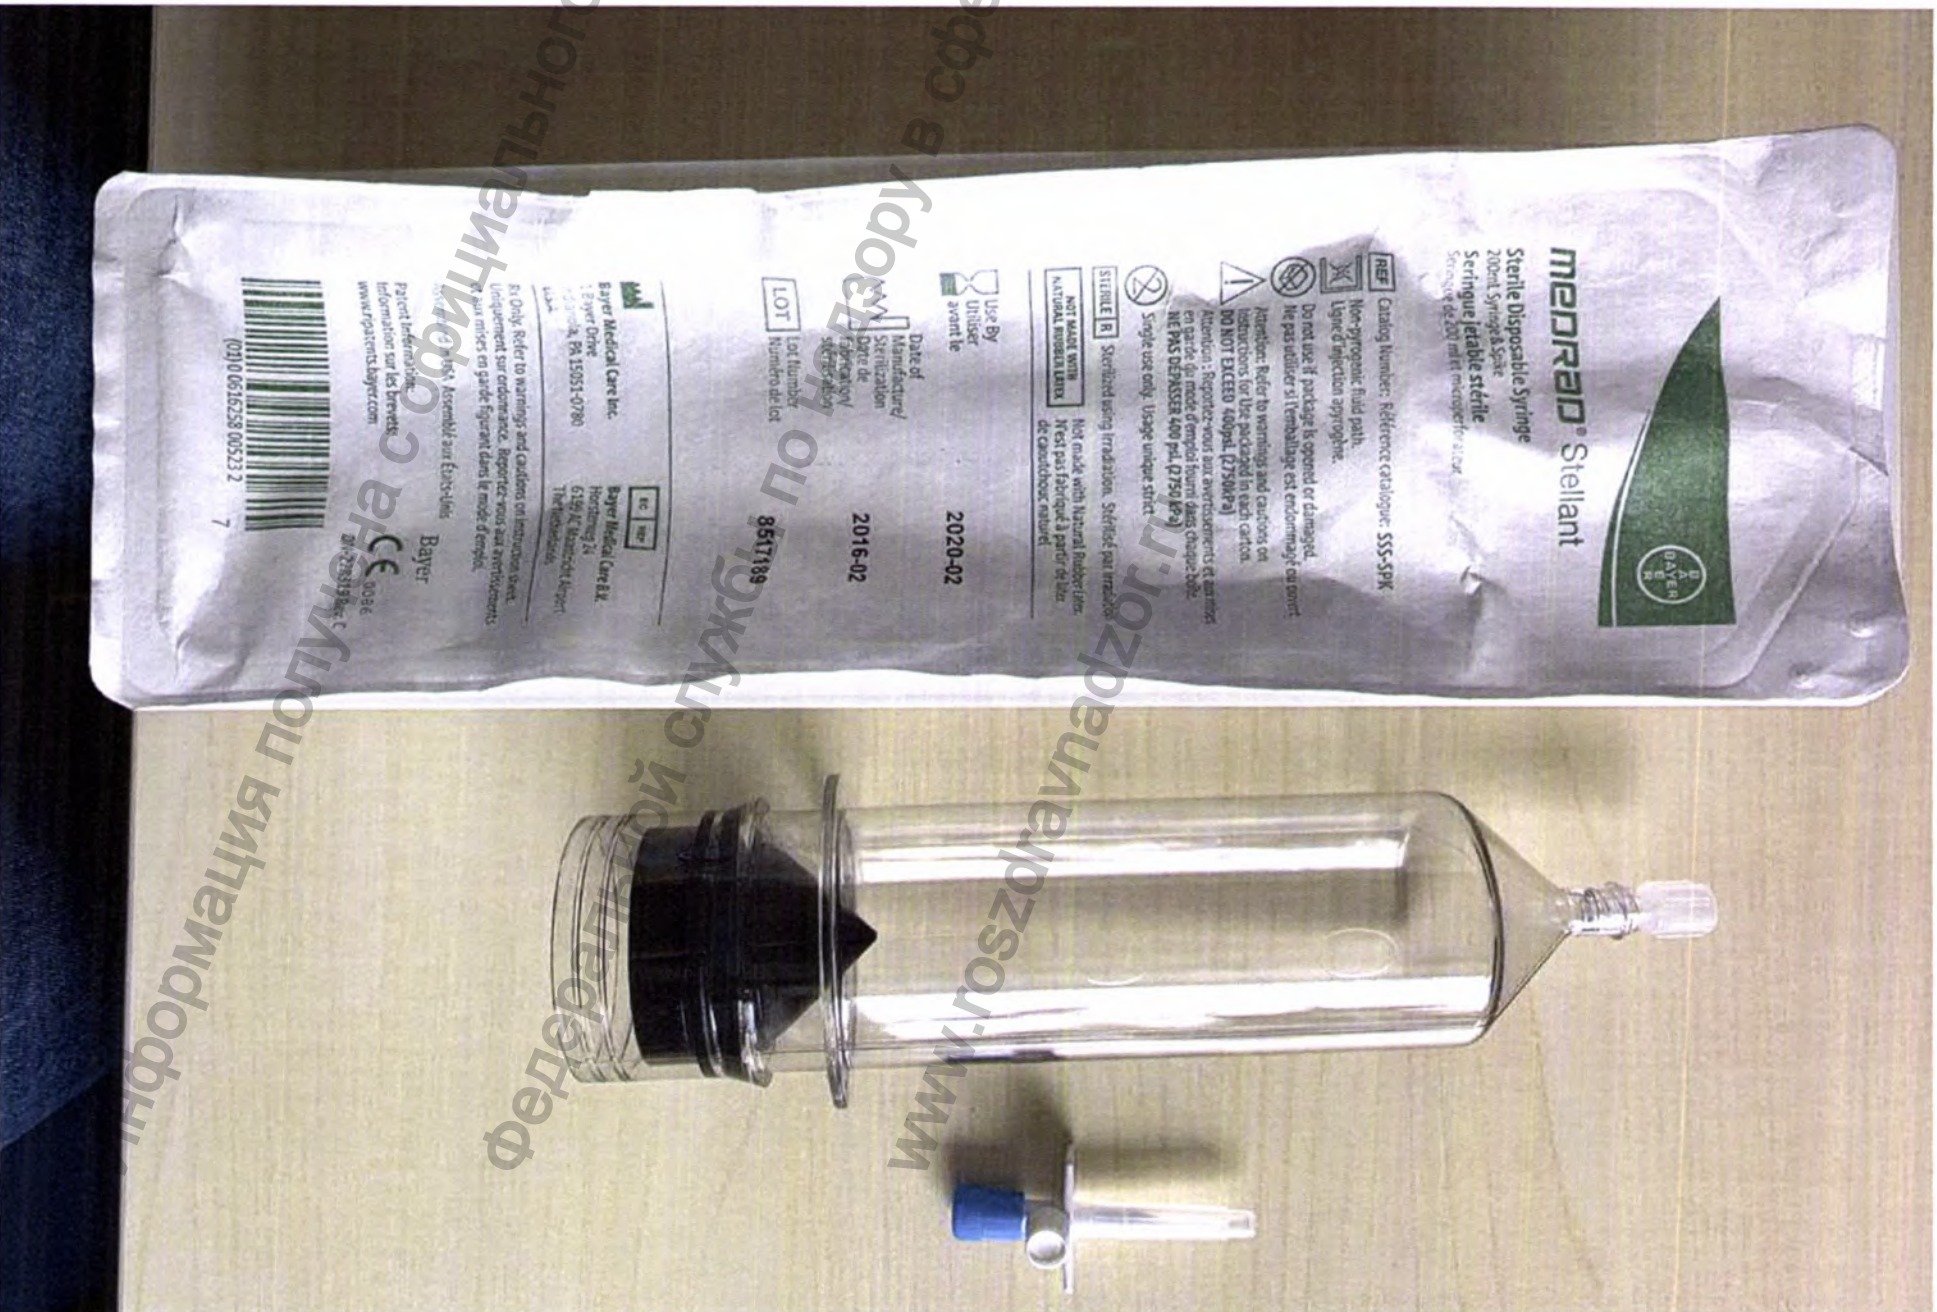

10. SSS-SPK Шприц стерильный одноразовый в наборе: 10.1Шприц 200 мл; 10.2Игла



МЕДРАД® Stellant

Sterile Disposable Syringe 200ml Syringe & Spike

Шприц стерильный одноразовый

Шприц 200 мл и игла

SSS-SPK

REF Catalog Number:
Номер по каталогу:

M Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged./Не
используйте вскрытые или поврежденные упаковки.

Attention: Refer to warnings and cautions on
instructions for use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 400psi. (2750kPa)/ВНИМАНИЕ! Для

получения дополнительных сведений о мерах
предосторожности и прочтите инструкции по применению,
вложенную в упаковку. **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2750 kPa**

Single use only
Использовать только один раз

STERILE R Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

**NOT MADE WITH
NATURAL RUBBER LATEX**
Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Assembled in USA

Use By
Использовать до

**Date of
Manufacture**
Дата
производства

LOT Lot Number
Номер партии

Производитель

Bayer Medical Care Inc.

Байер Медикал Кэа Инк., США

1 Bayer Drive
Irida, PA 15051-0780
USA

ЕС **НЕР**

Bayer Medical Care B.V.

Hoisterweg 24

6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Средства СМД

Импортер на территорию

России: АО «Байер»

Бизнес-юнит «Радиология»,

107113, 3-я Рыбинская ул.,

д.18 стр.2, Москва, Россия

тел: 7 495 231 1200



Байер

Patent Information/
Патентная информация:
www.patents.bayer.com



0056

РУ № ФСЗ 2012/12543
от 26 февраля 2016 года

DN-246018 Rev. A



Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке SSS-SPK



11. SDS-TRF-CV Шприц стерильный одноразовый в наборе: 11.1 Шприцы 200 мл – 2шт; 11.2 Трубка Т-образная соединительная 152,4 см; 11.3 Трубка для прокачки воздуха; 11.4 Переходники с обратным клапаном – 2 шт.



medrad® Stellant

Sterile Disposable Syringe

2 - 200mL Syringes, 1 - 60" T-Connector and Prime Tube,
2 - Check Valve Transfer Sets

Шприц стерильный одноразовый

2 - Шприцы 200 мл, 1 - Трубка Т-образная соединительная
152, 4 см и Трубка для прокачки воздуха, 2 - Переходники с
обратным клапаном

REF Catalog Number: **SDS-TRF-CV**
Номер по каталогу:

Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged.
Не используйте вскрытые или поврежденные
упаковки

Attention: Refer to warnings and cautions on
Instructions for Use packaged in each carton
DO NOT EXCEED 350psi. (2410kPa)/ВНИМАНИЕ! Для
получения дополнительных сведений о мерах
предосторожности изучите инструкцию по применению,
вложенную в упаковку **НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 2410 кПа**

Single use only/Использовать только один раз

STERILE R Sterilized using Irradiation
Стерилизовано с использованием облучения

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX Not made with Natural Rubber Latex
Сделано без применения
натурального латекса

Rx Only Assembled in USA

Use By
Использовать до

Date of
Manufacture
Дата
производства

LOT Lot Number
Номер партии

Производитель
Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэа Инк., США
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.

EC REP
Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Сделано в США

Patent Information/
Патентная информация:
www.ripatents.bayer.com

Bayer



Импортер на территорию
России: АО «БАЙЕР»
Бизнес-юнит «Радиология»,
107113, 3-я Рыбинская ул.,
д.18, стр.2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

CE 0086 **РУ № ФСЗ 2012/12543**
от 26 февраля 2016 года DN-246022 Rev. A



(01) 00616258011103

Проект маркировки индивидуальной (стерильной) упаковки на русском языке SDS-TRF-CV

Информация получена с официального сайта
www.goszdravnadzor.ru
сервисной службы по надзору в сфере здравоохранения



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
24
листа (ов)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru