

7

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Царахина

2019 г



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ**

**«Система ультразвуковая диагностическая
медицинская Vscan Extend с принадлежностями»**

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.gov.ru

1. Консоль с ультразвуковым датчиком





2. Кенцоль с ультразвуковым датчиком



GE Vingmed Ultrasound A/S 5721785_05
Strandpromenaden 45
3191 Horten Norway



    0123

  "5693456"
- 12V 2A IP33

 Référez-vous à l'étiquette figurant à l'intérieur
Siehe auch Innereinfassung
Consultare l'etichetta interna
Refer label inside Assembled in Romania


SN  VH163025XB
5754412_03

 Vscan Extend P/N 5693455


  (01)00840682121651
(11)181000
(21)VH163025XB


5758266-01

4. Сетевой адаптер питания

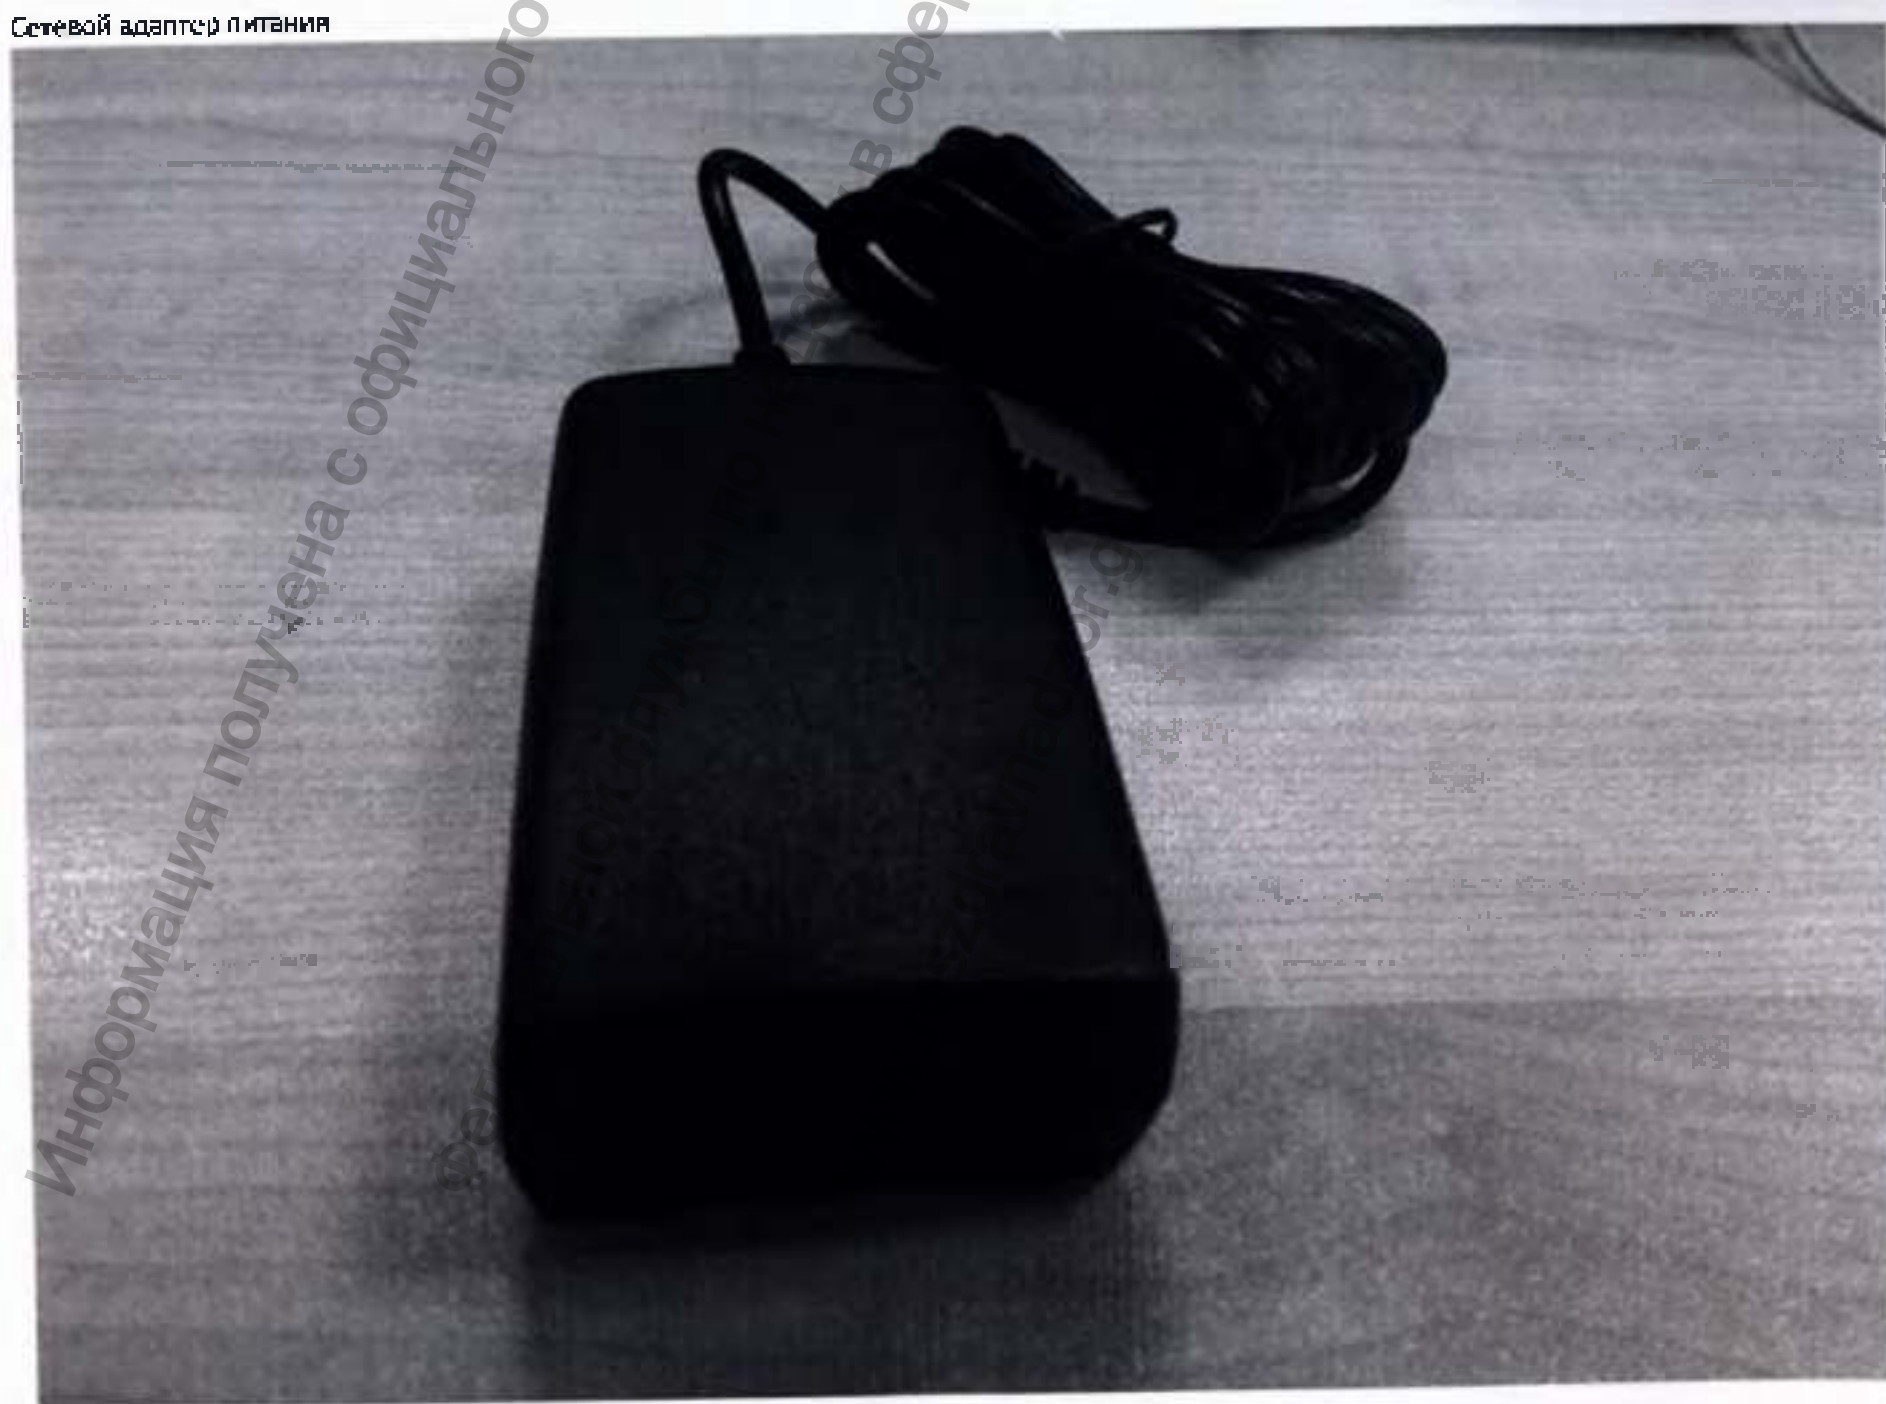

5. Инструкция пользователя на русском языке (не более 5 шт.)

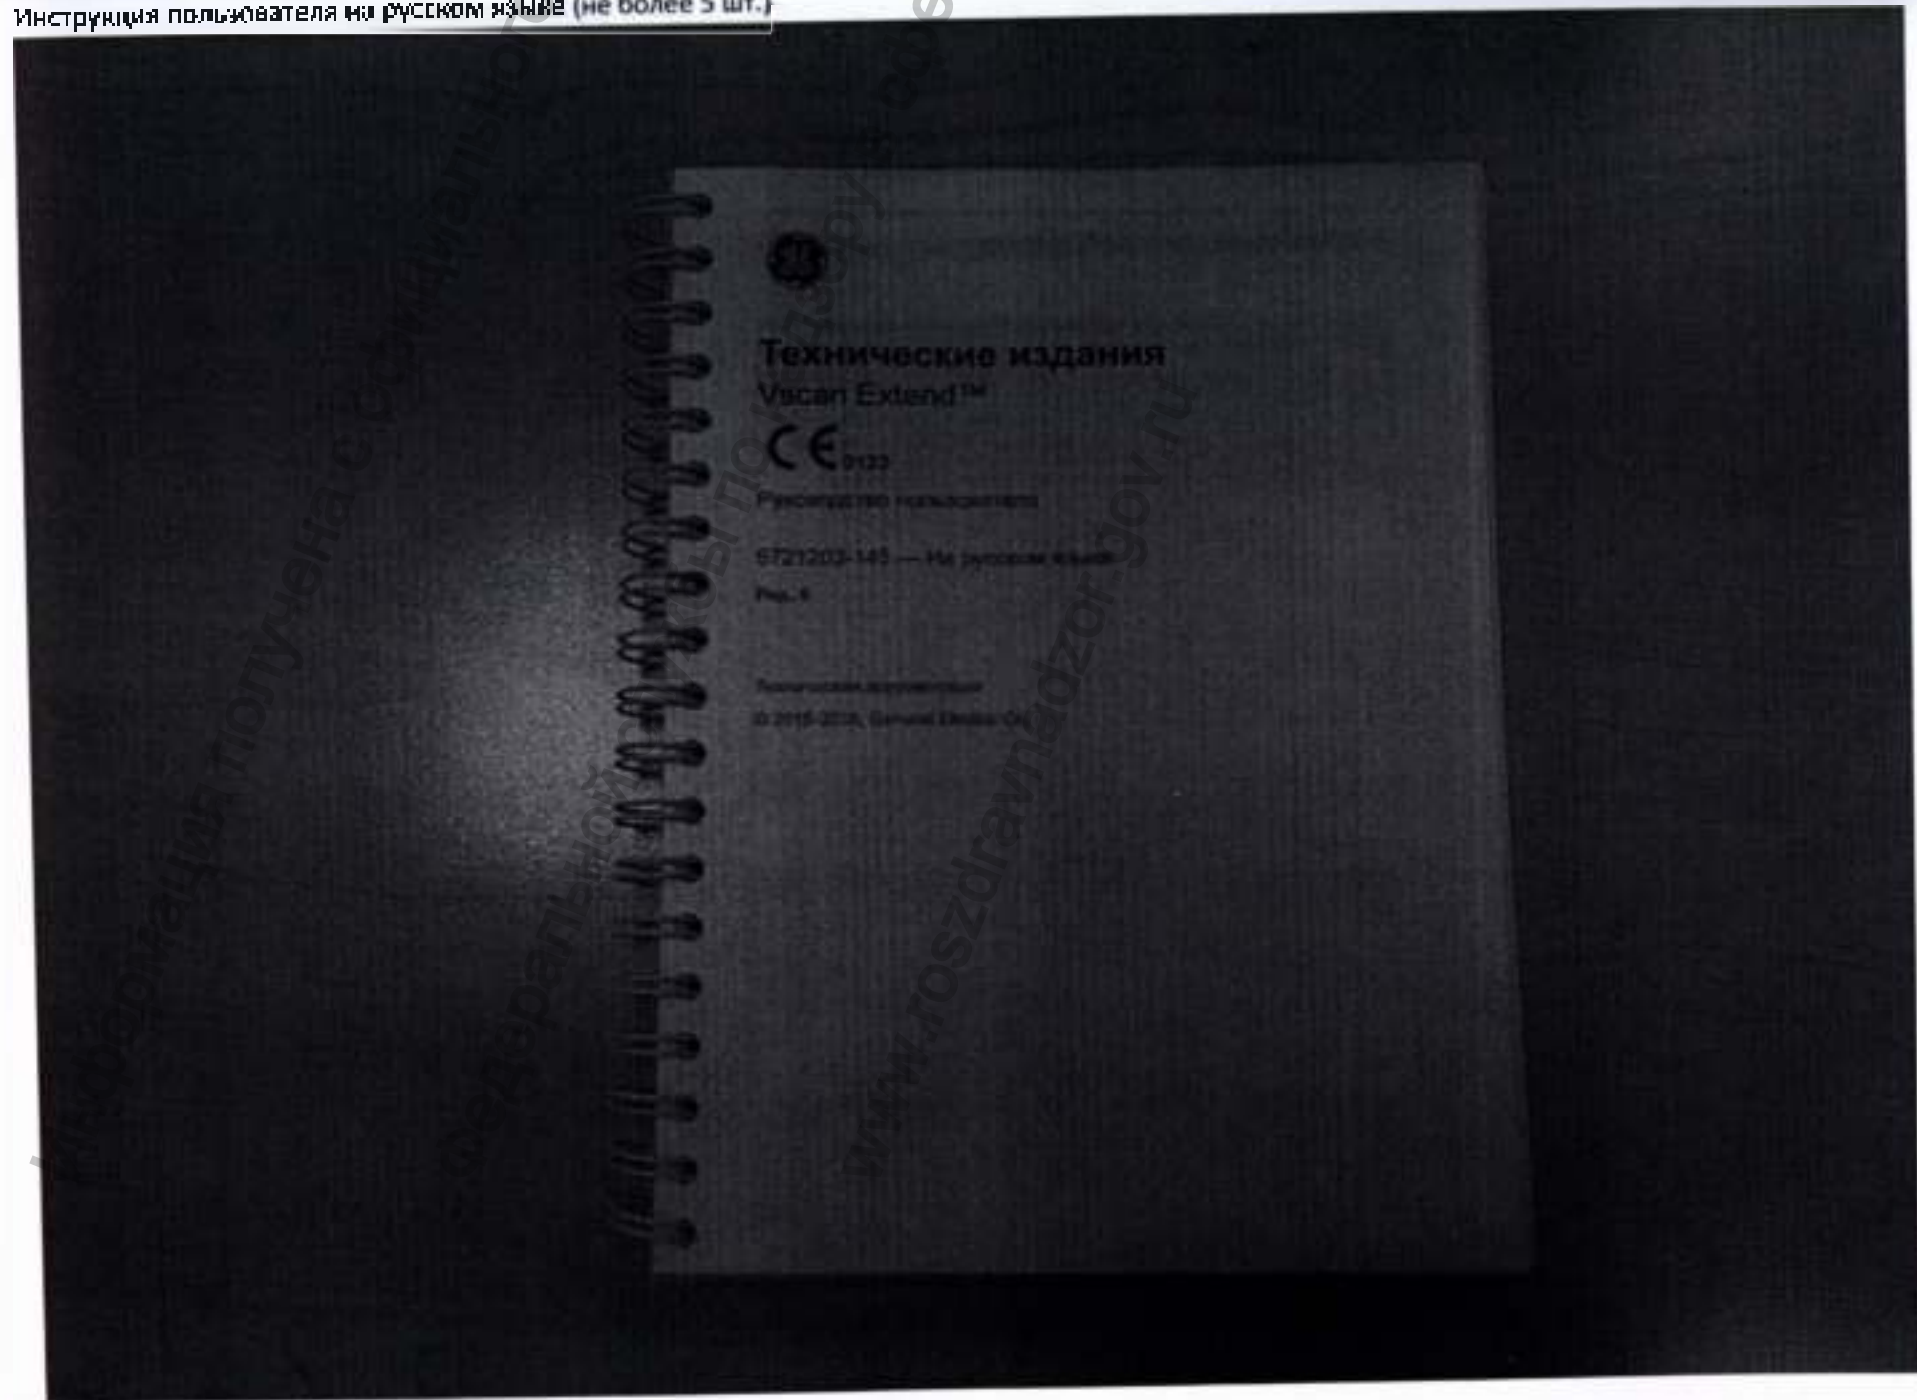


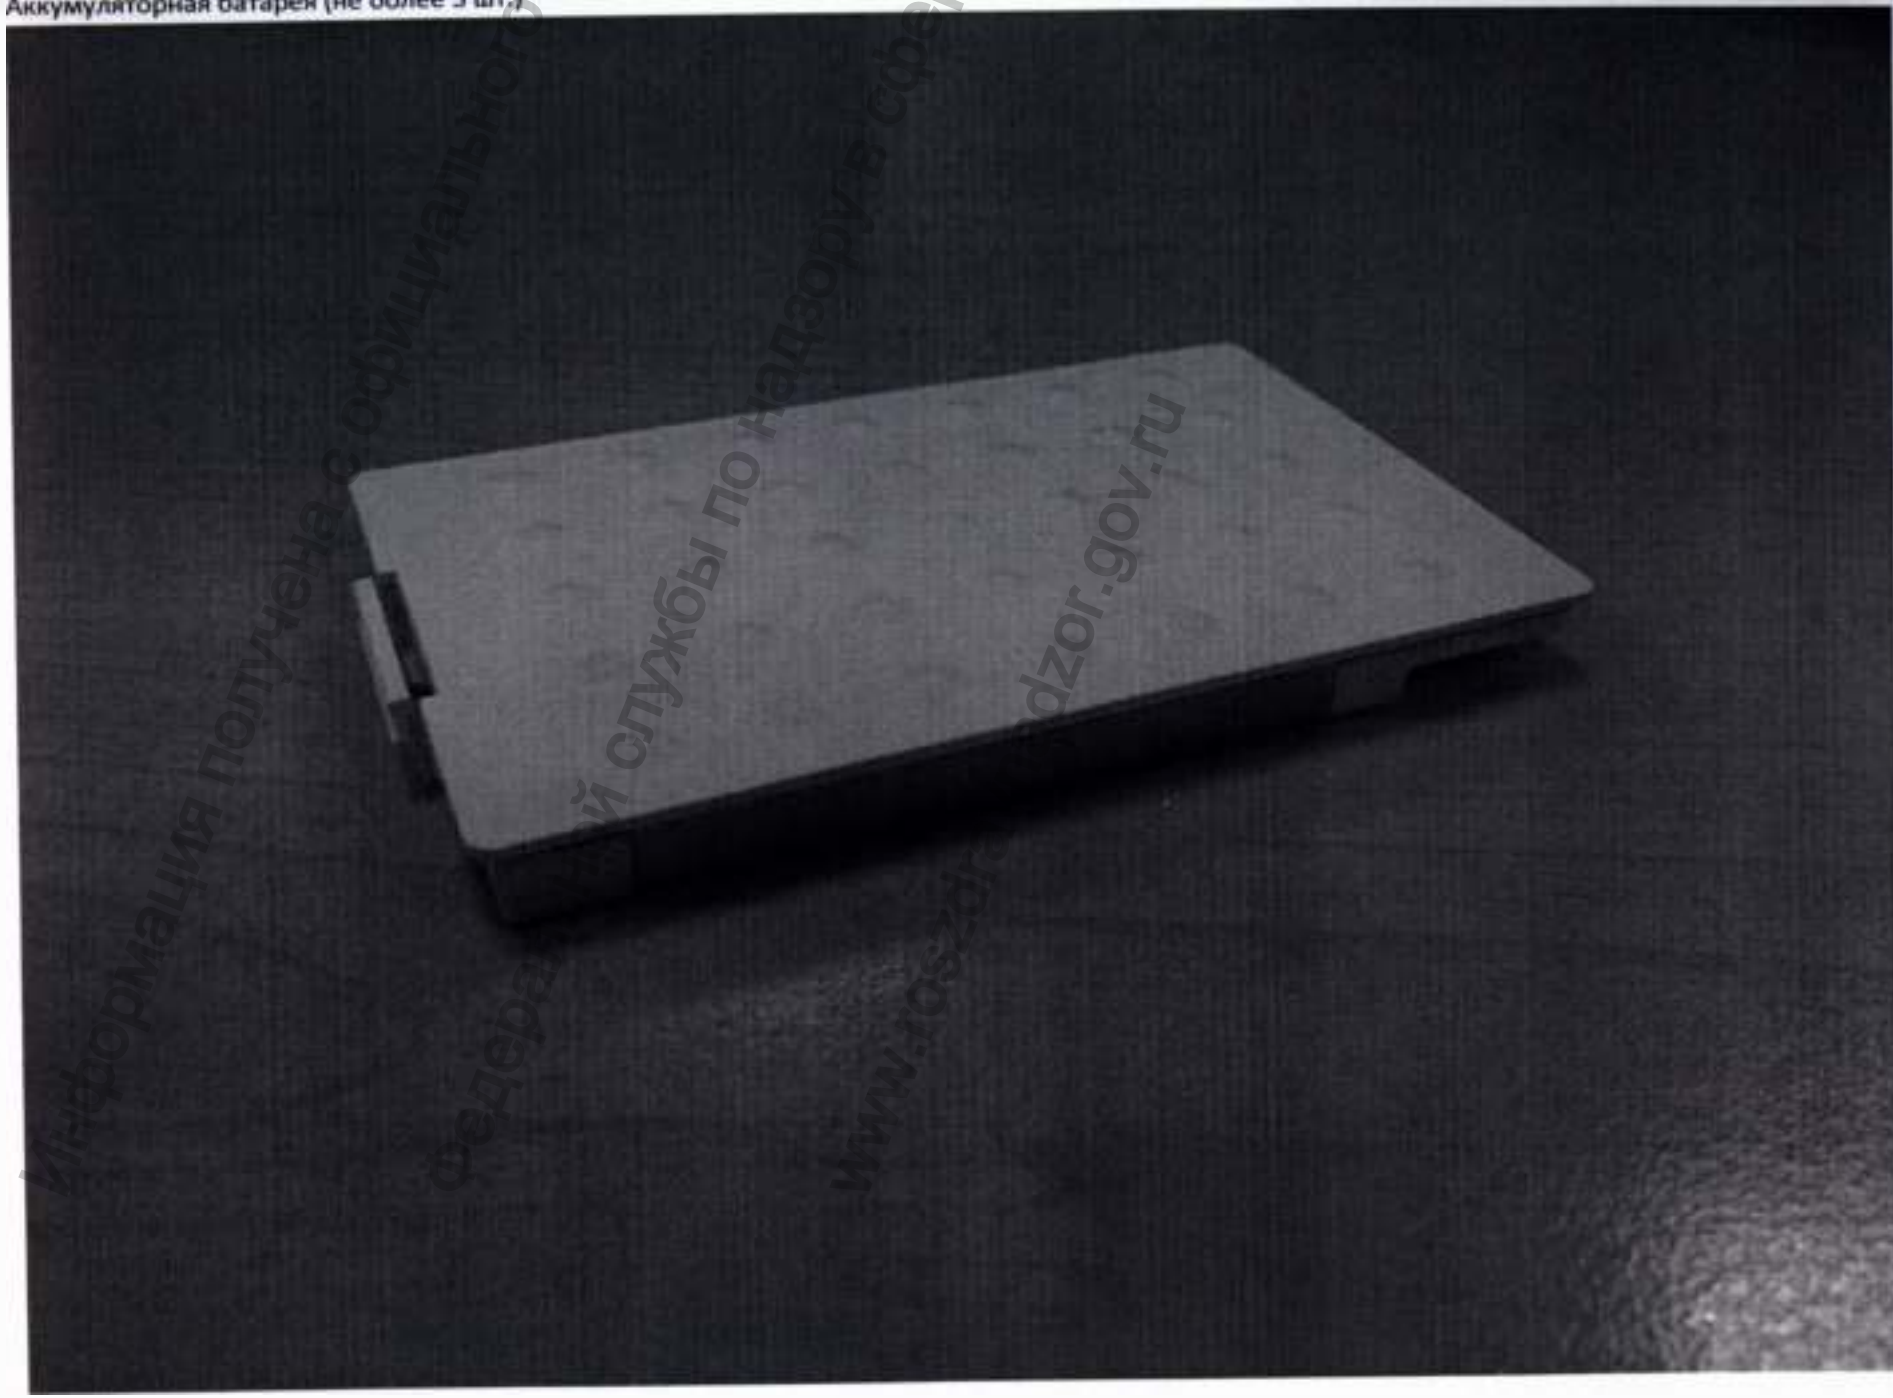




Информация получена с официального
Федеральной службы

www.roszdrmedzor-s

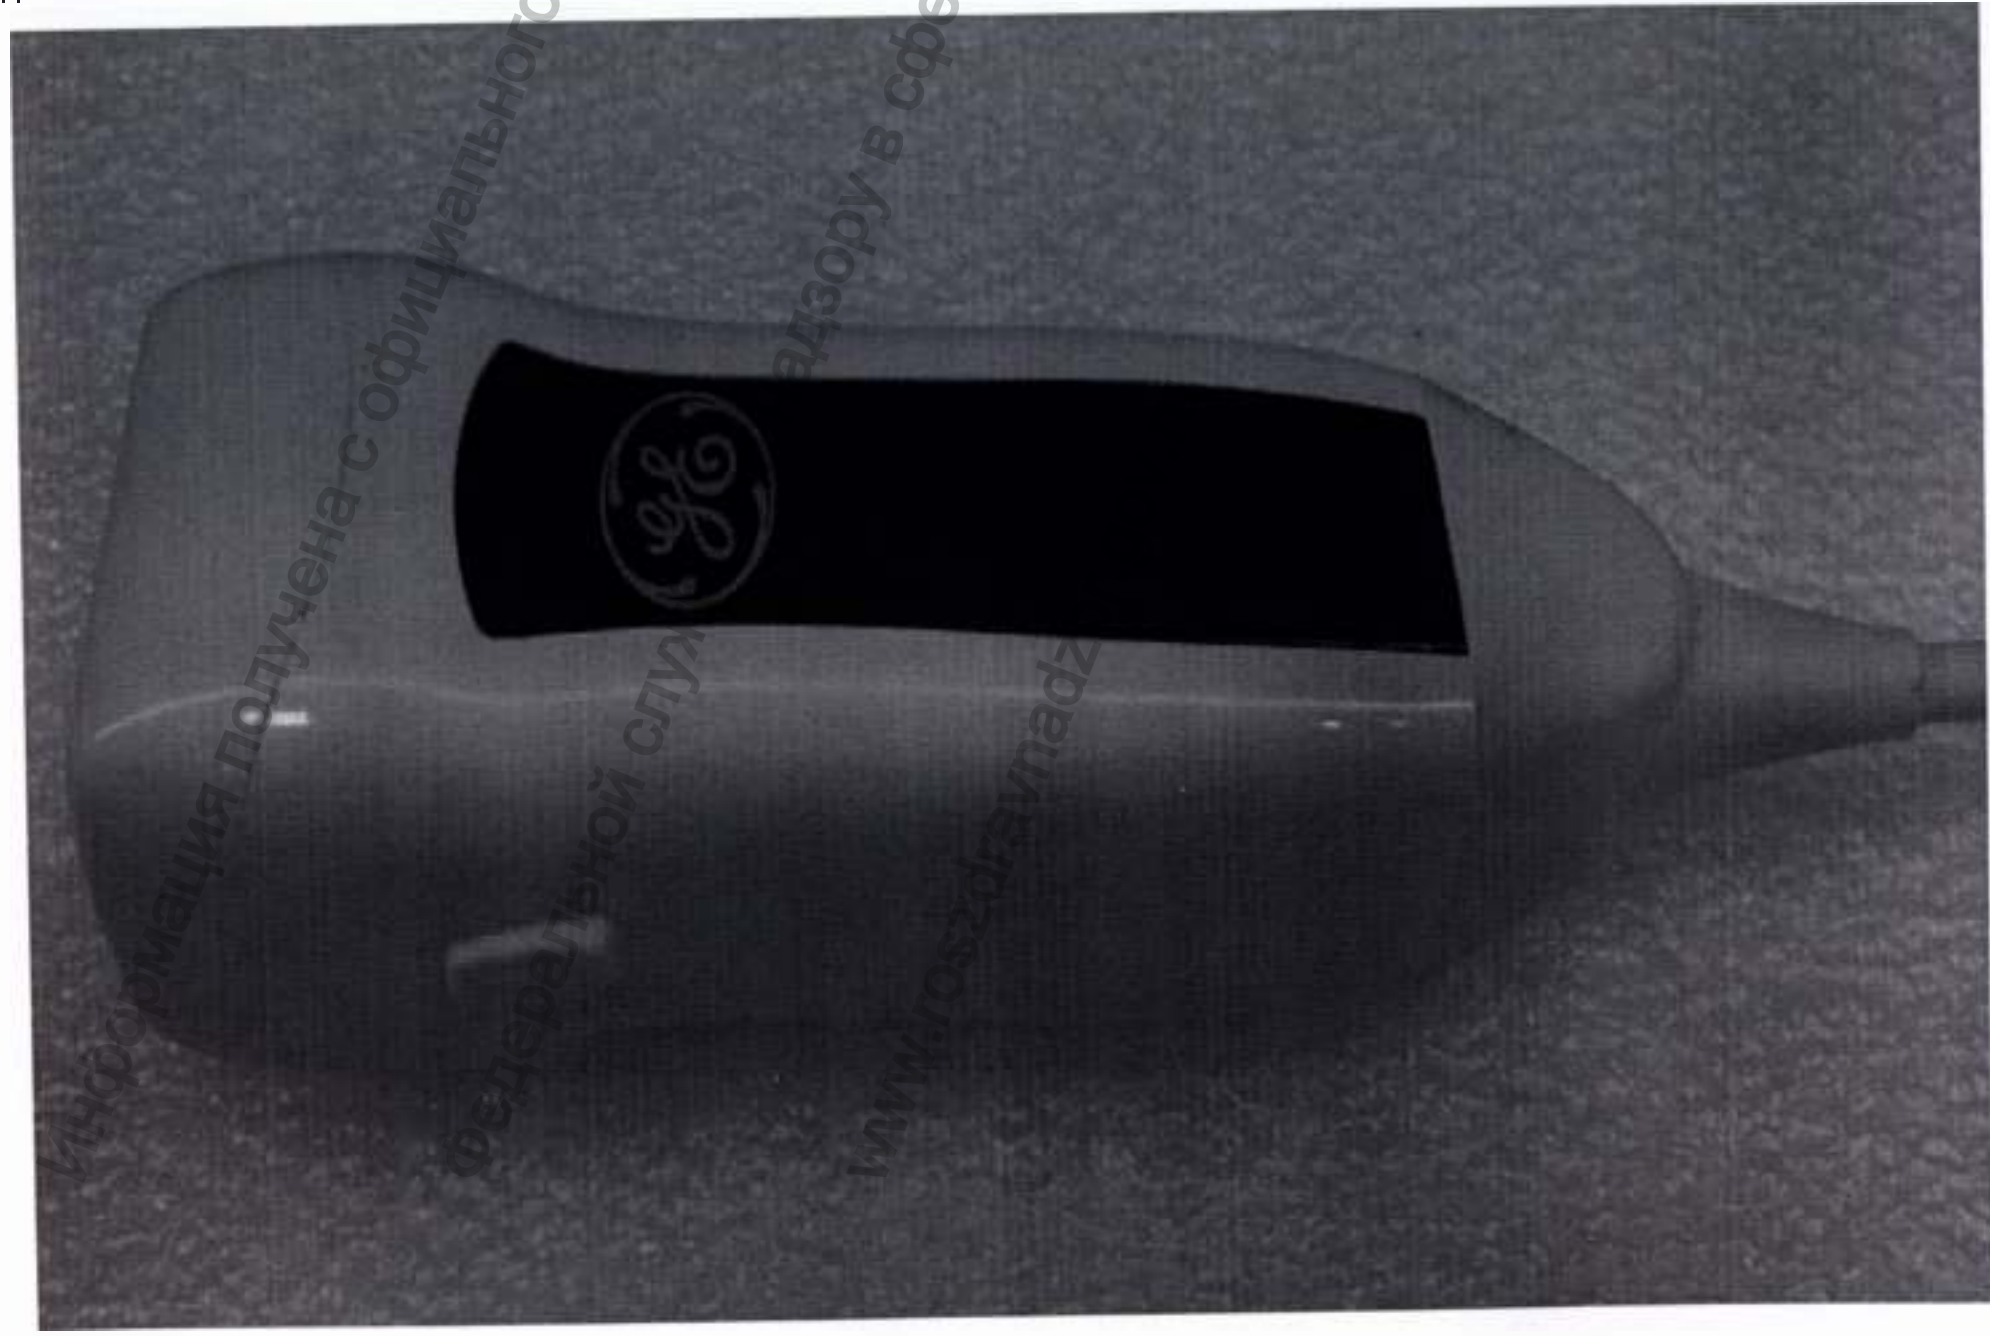

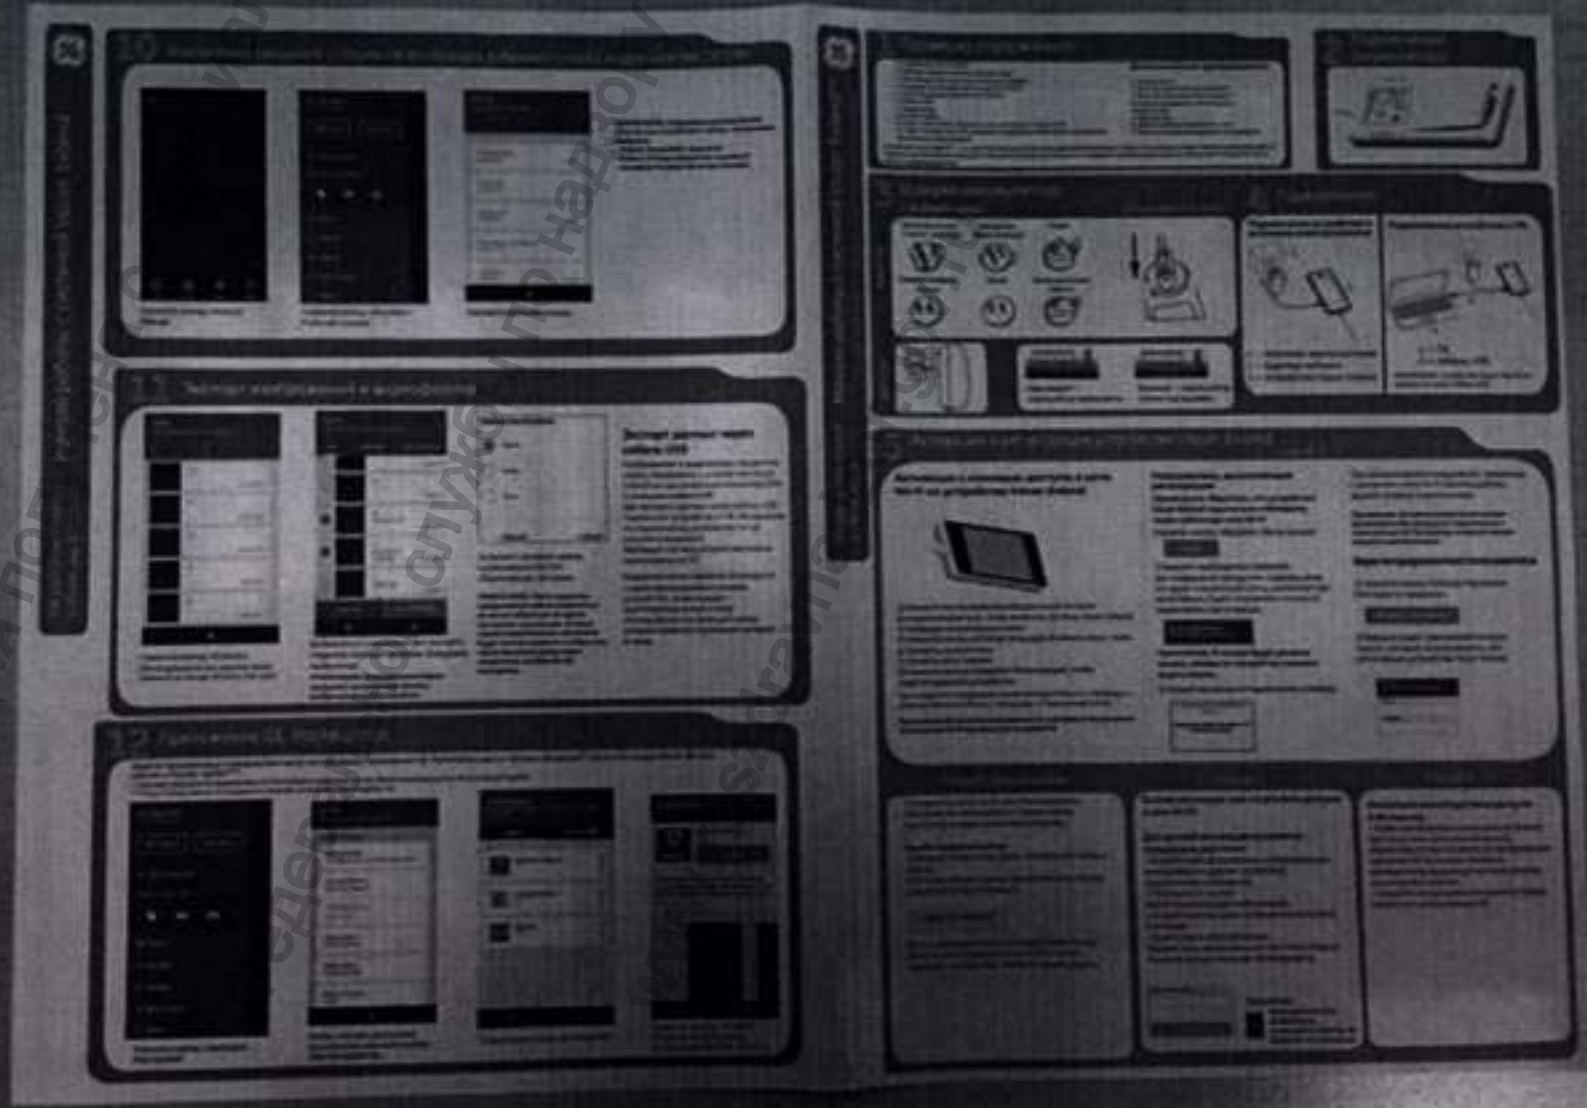







10. Футляр для транспортировки сканера и принадлежностей



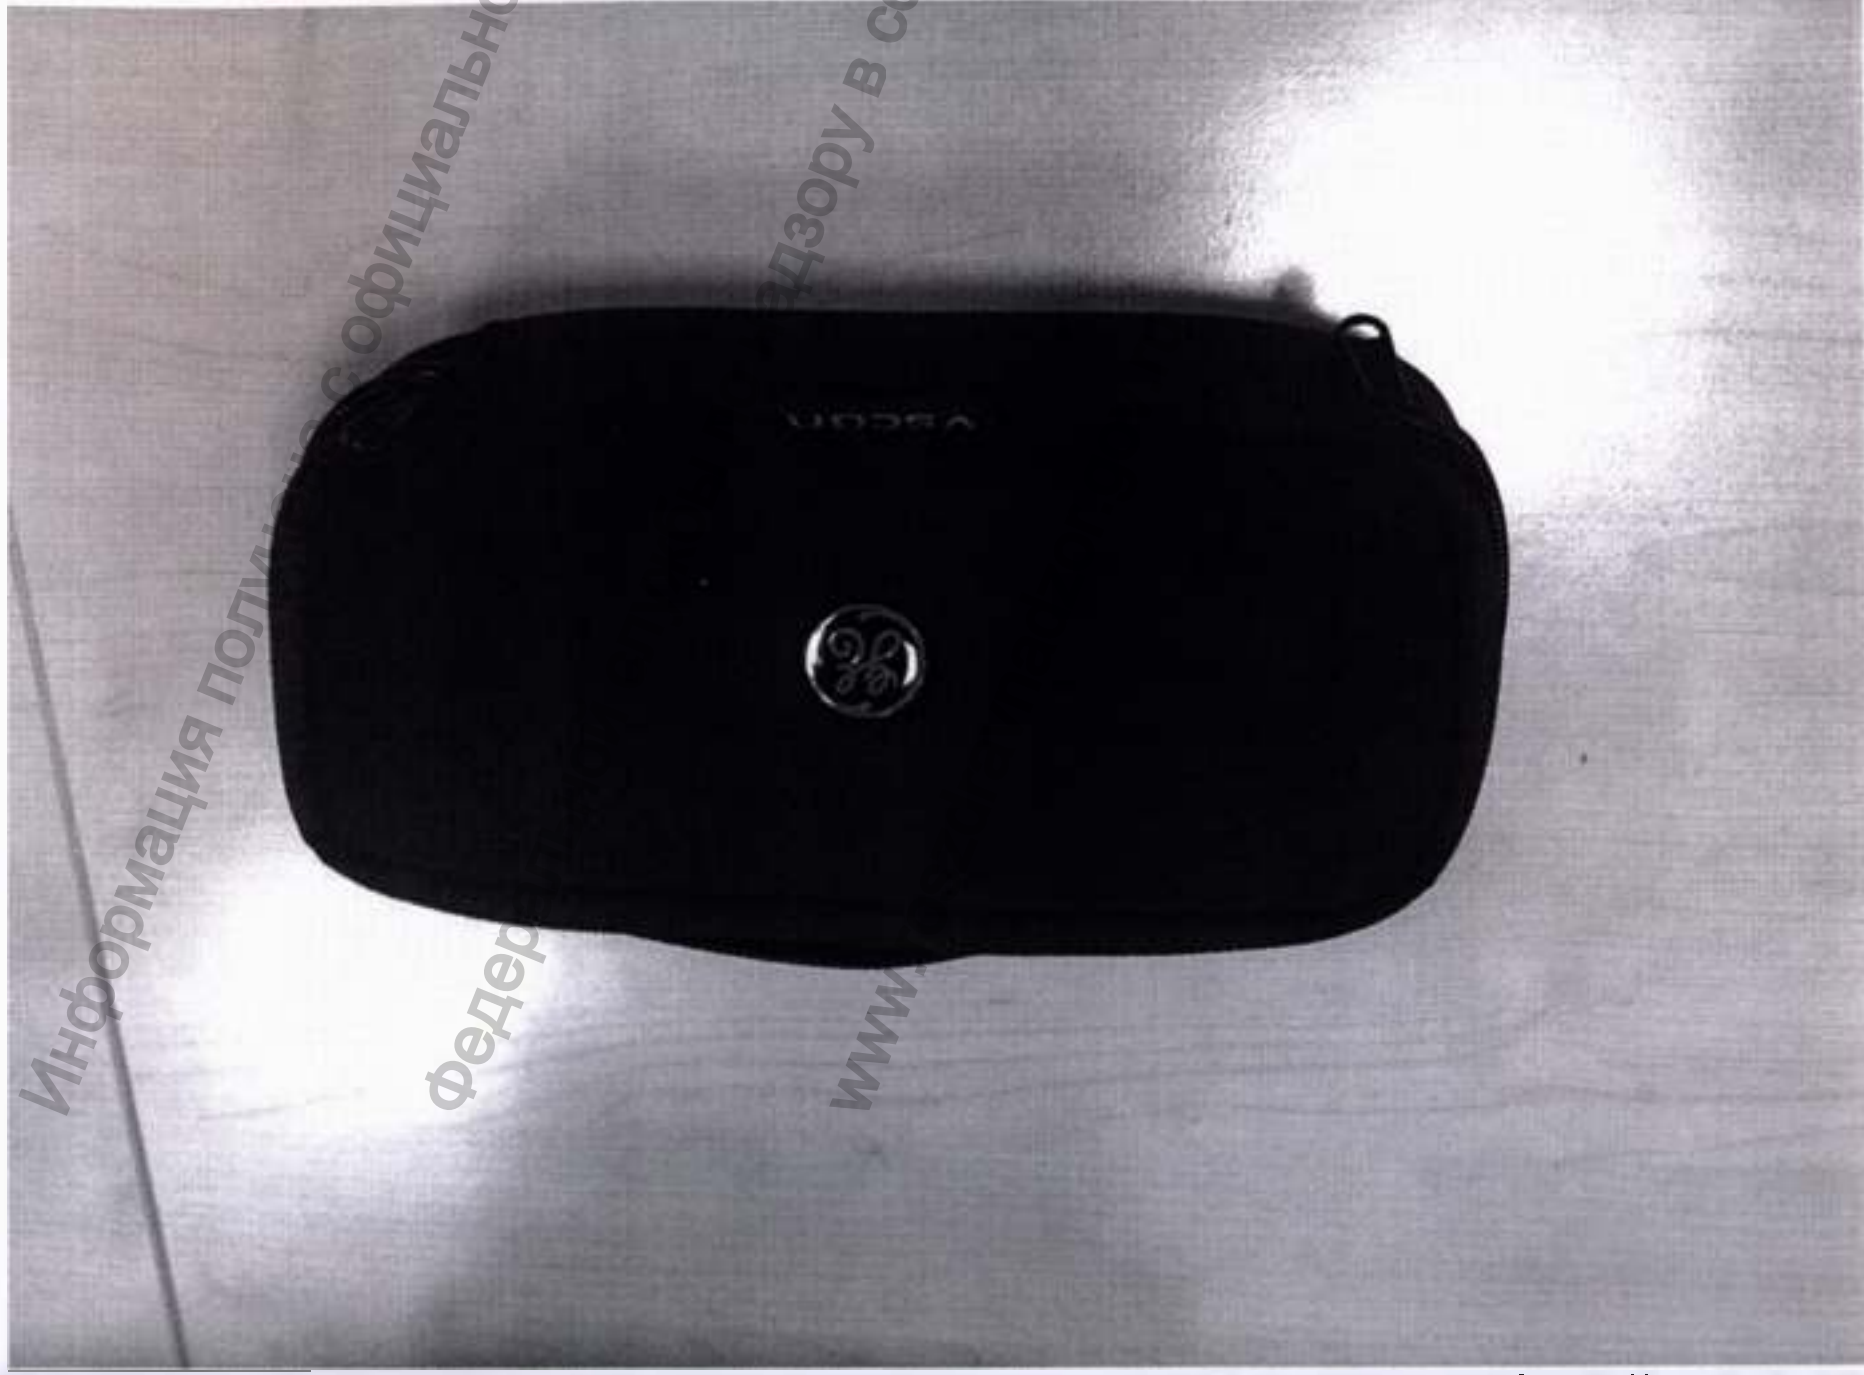

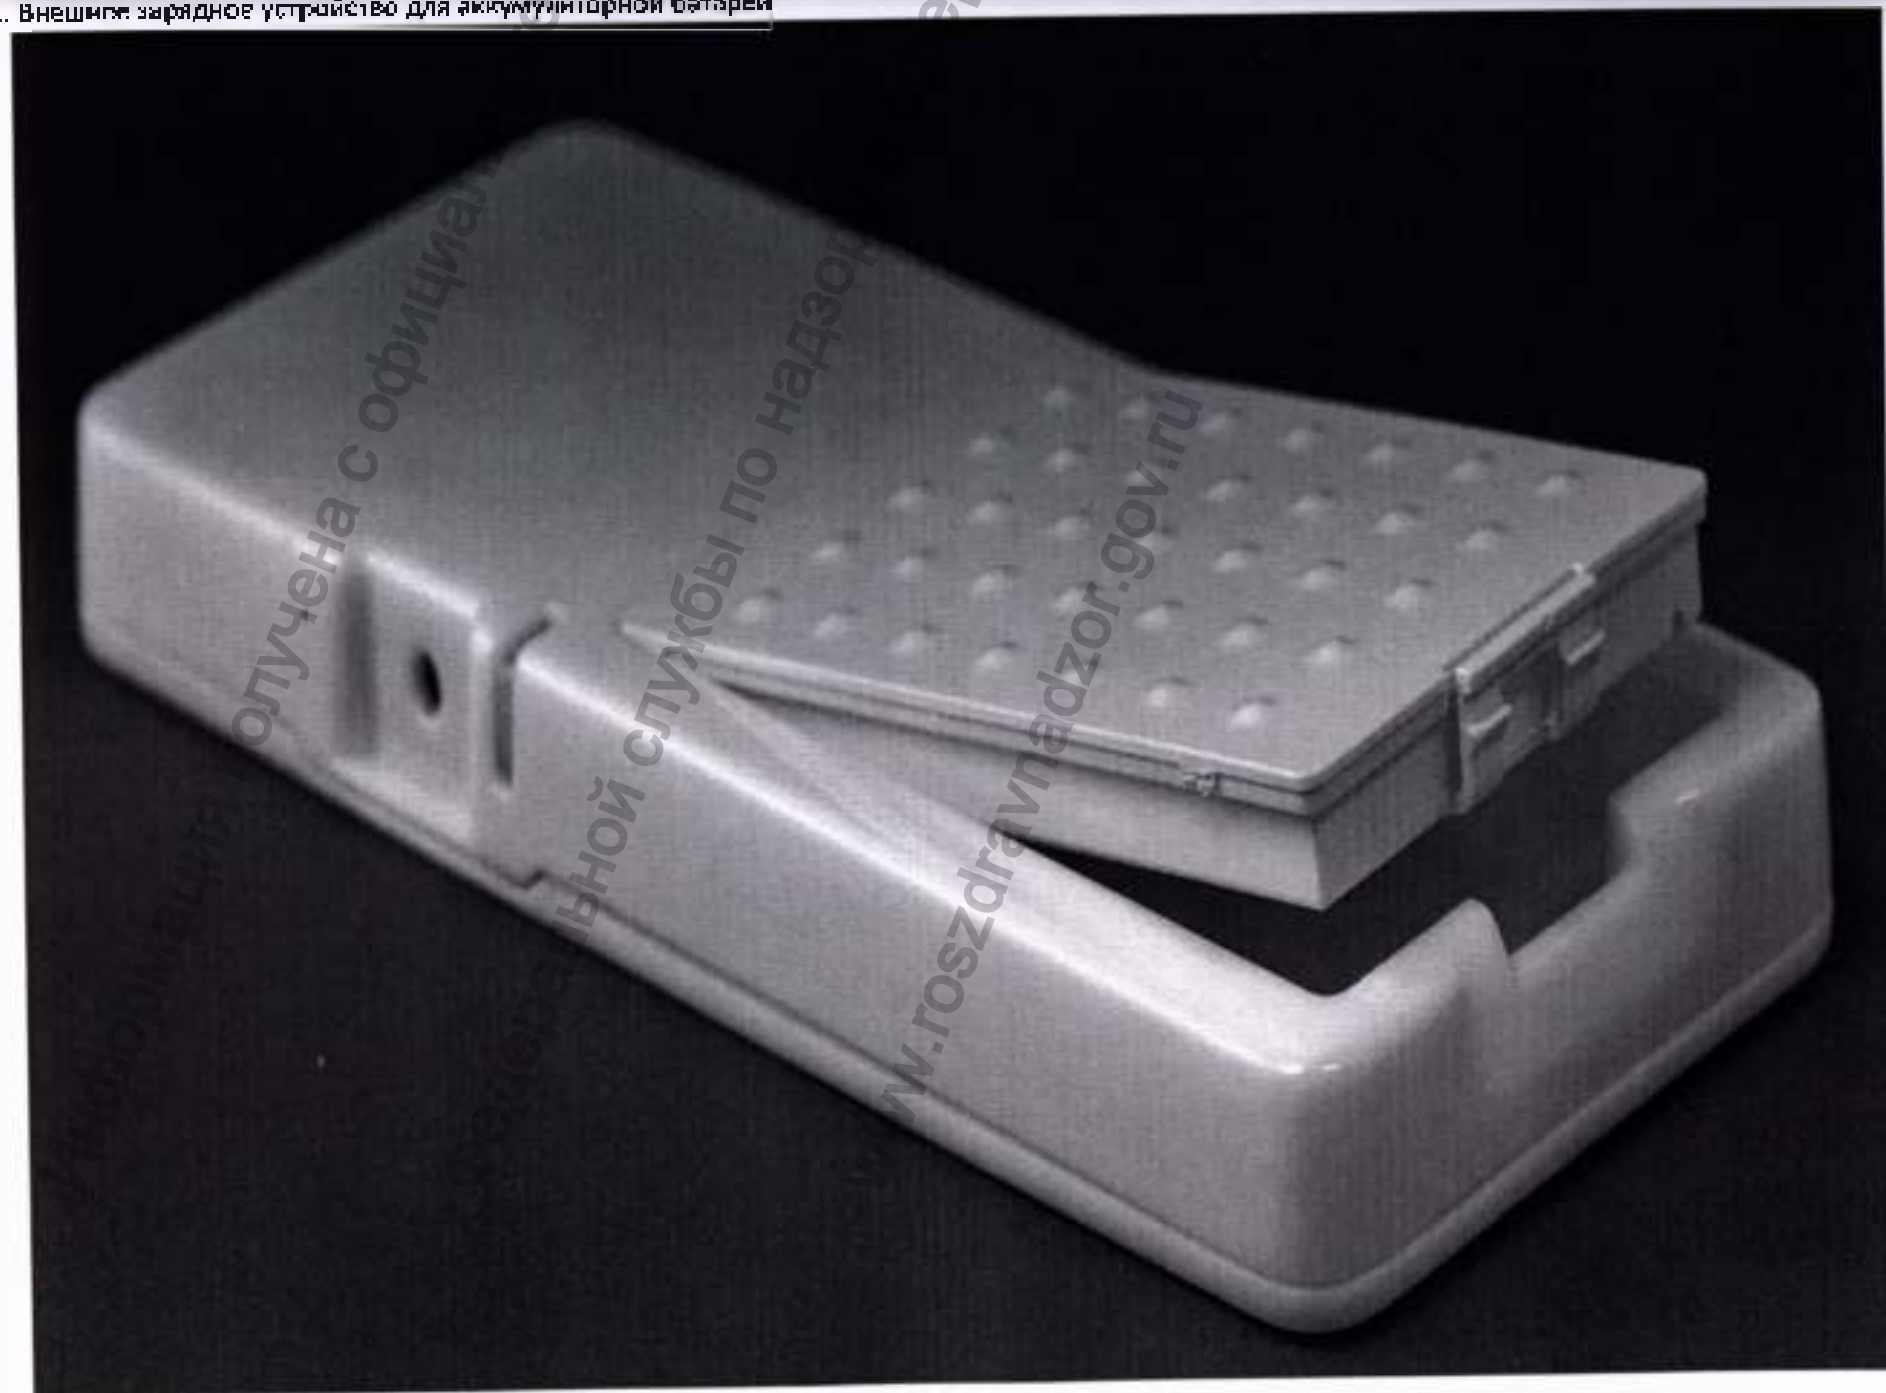



14. Программный модуль для поддержки передачи данных по интерфейсу USB с возможностью добавления передачи по беспроводному интерфейсу, активируемый штепсельным ключом

Configuration

View your current device setup

Enabled Modules



Ophthalmic



DICOM Configuration




Wireless Windows Share



GE Marketplace

Enter a key

5. Программный модуль для передачи данных по беспроводному интерфейсу с возможностью интеграции в DICOM сеть, активируемый электронным ключом.

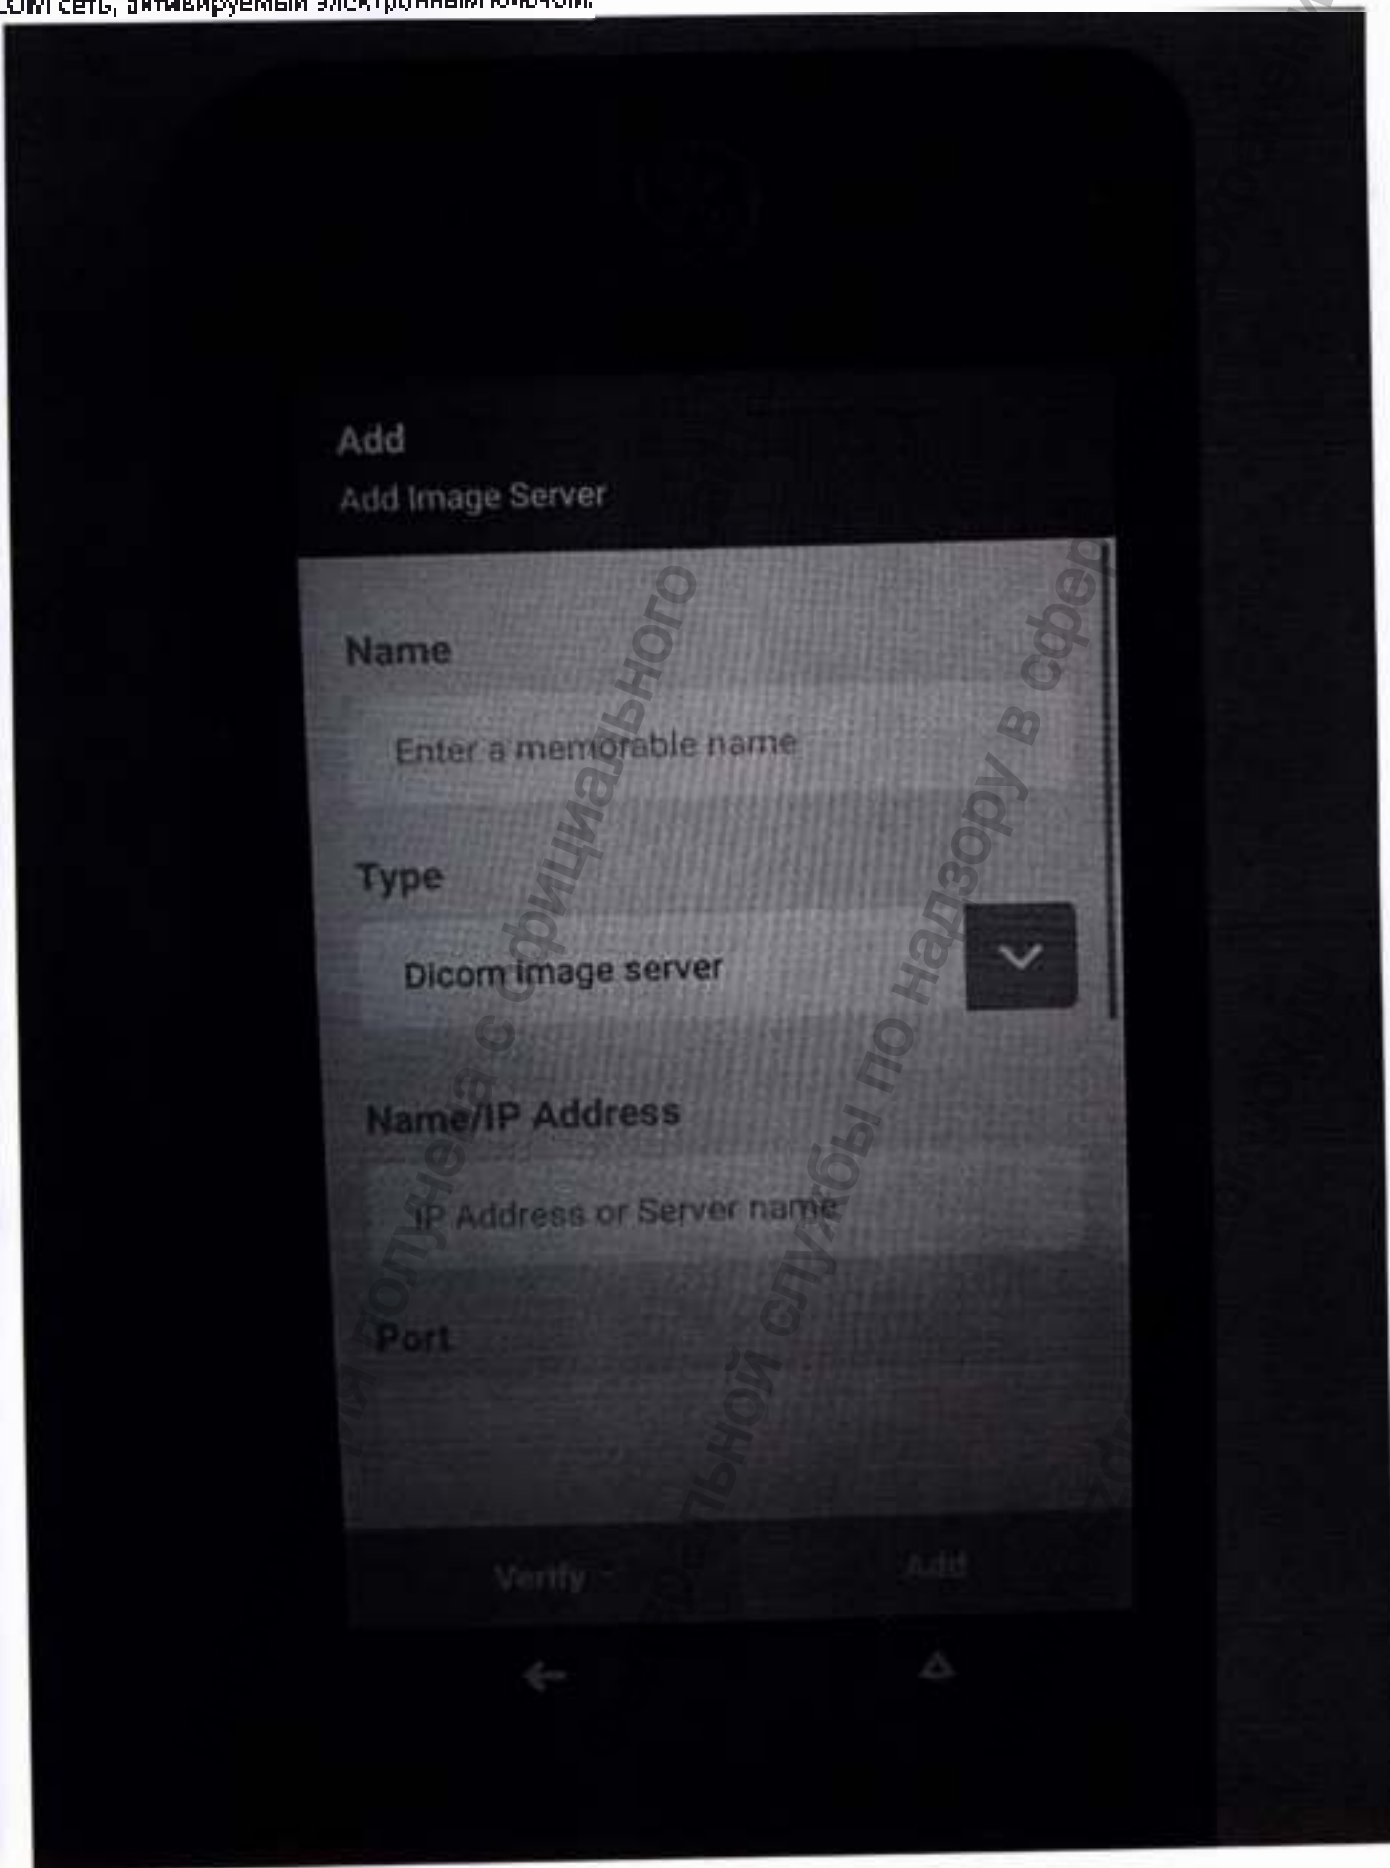

6. Программный модуль для передачи данных по интерфейсу USB с возможностью интеграции в DICOM сеть, активируемый электронным ключом.



Vscan Extend

Connected to PC. Please wait .

• Storage

10.17 GB (91.45 % free)

7. Программный модуль для автоматического определения границы левой стенки миокарда и вычисления объемов левого желудочка и фракции выброса, интегрируемый электронным ключом.





Report information

The file already exists.


00006524.PDF

Open

Do you want to overwrite it?

Yes

No

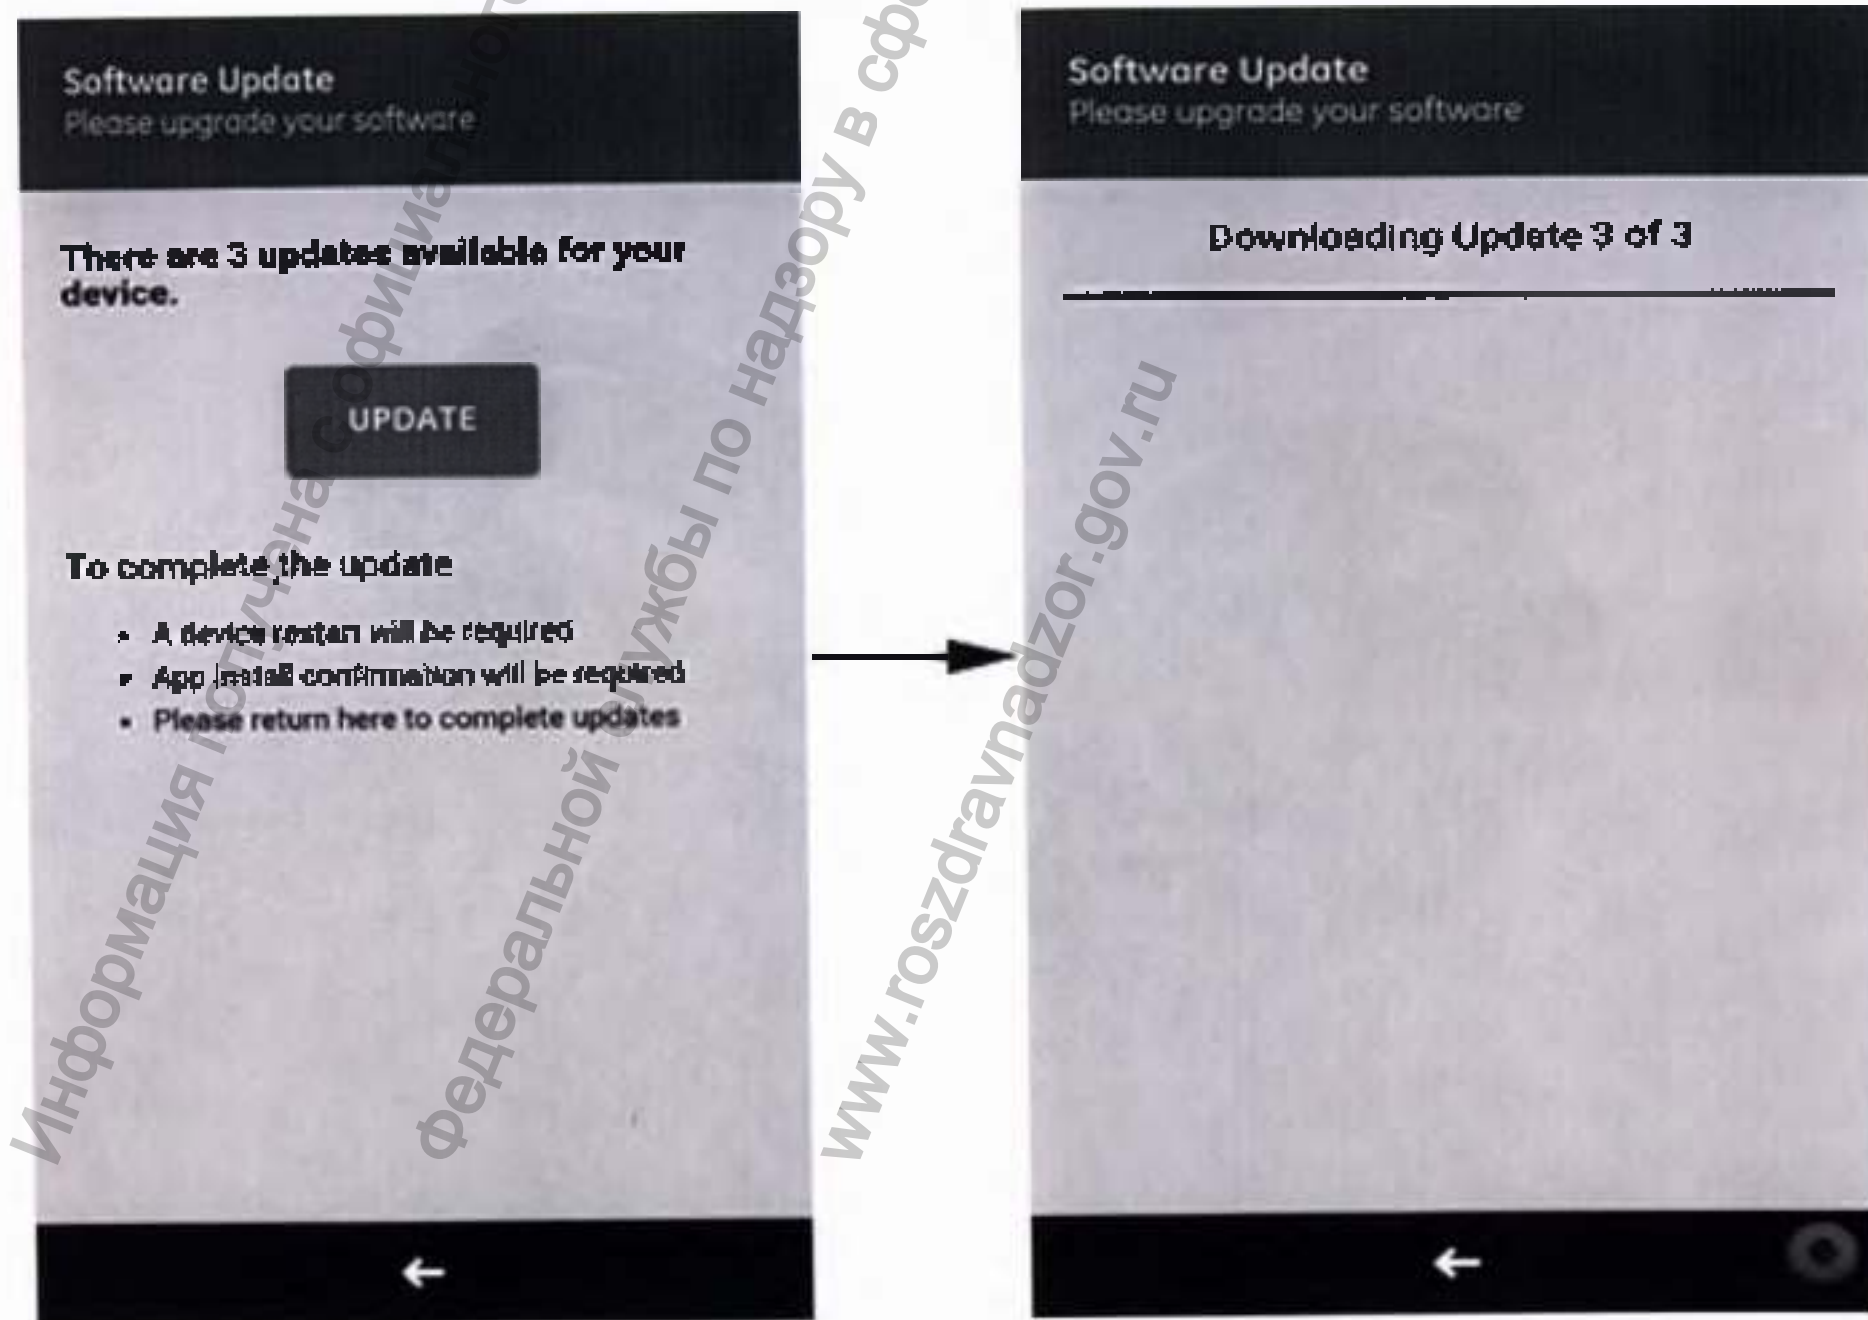

21. Кабель интерфейсный для подключения к планшету (не более 3 шт.)





Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____
Руководитель департамента регистрации
и сертификации России и СНГ
ООО «Джи Си Резерс» _____
Парахина С.Б.

www.goszdravnadzor.ru